# Pile Dynamics, Inc.
# Transducer 112I

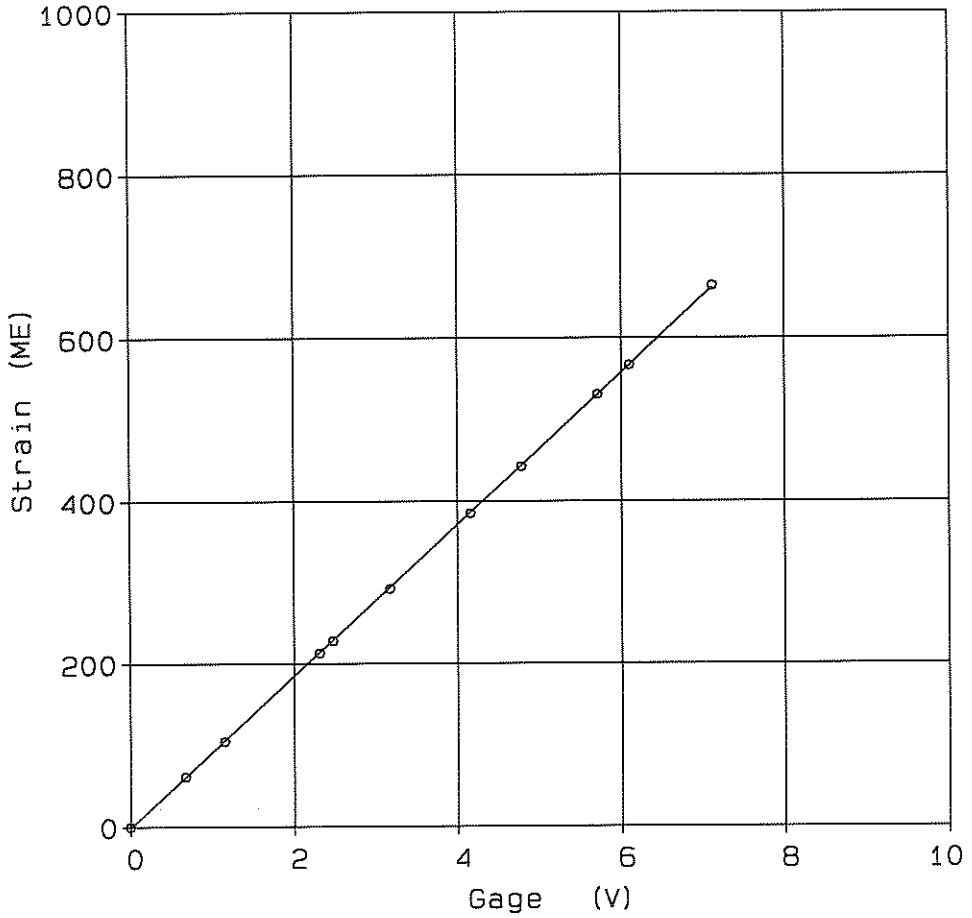


PDA Cal Factor = 93.3 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 323.8 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

| Strain ME | Gage V |
|---|---|
| 0 | .00 |
| 62 | .68 |
| 106 | 1.16 |
| 213 | 2.31 |
| 228 | 2.48 |
| 292 | 3.17 |
| 386 | 4.16 |
| 443 | 4.78 |
| 532 | 5.72 |
| 567 | 6.10 |
| 664 | 7.12 |

Calibrated by: J. Davidoff

Calibrated on: 24-Sep-96

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2