Pile Dynamics, Inc.

Transducer 1241

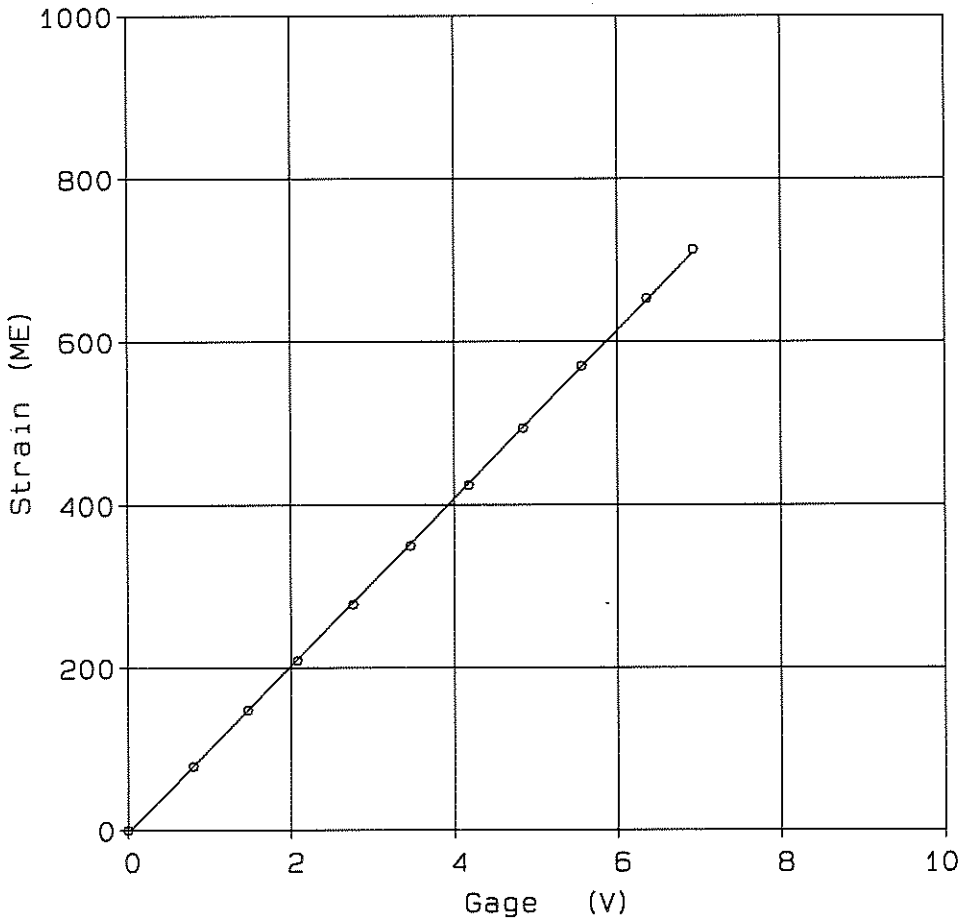

PDA Cal Factor	=	102.9 ME/V
Shunt (60.4KO)	=	5.0 V
General Factor	=	357.5 ME/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
80	.80
148	1.48
210	2.09
279	2.77
350	3.47
425	4.18
494	4.85
570	5.58
653	6.36
713	6.93

Calibrated by: Joe Berns

Calibrated on: 23-Jun-95

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2