Pile Dynamics, Inc.

Transducer 125I

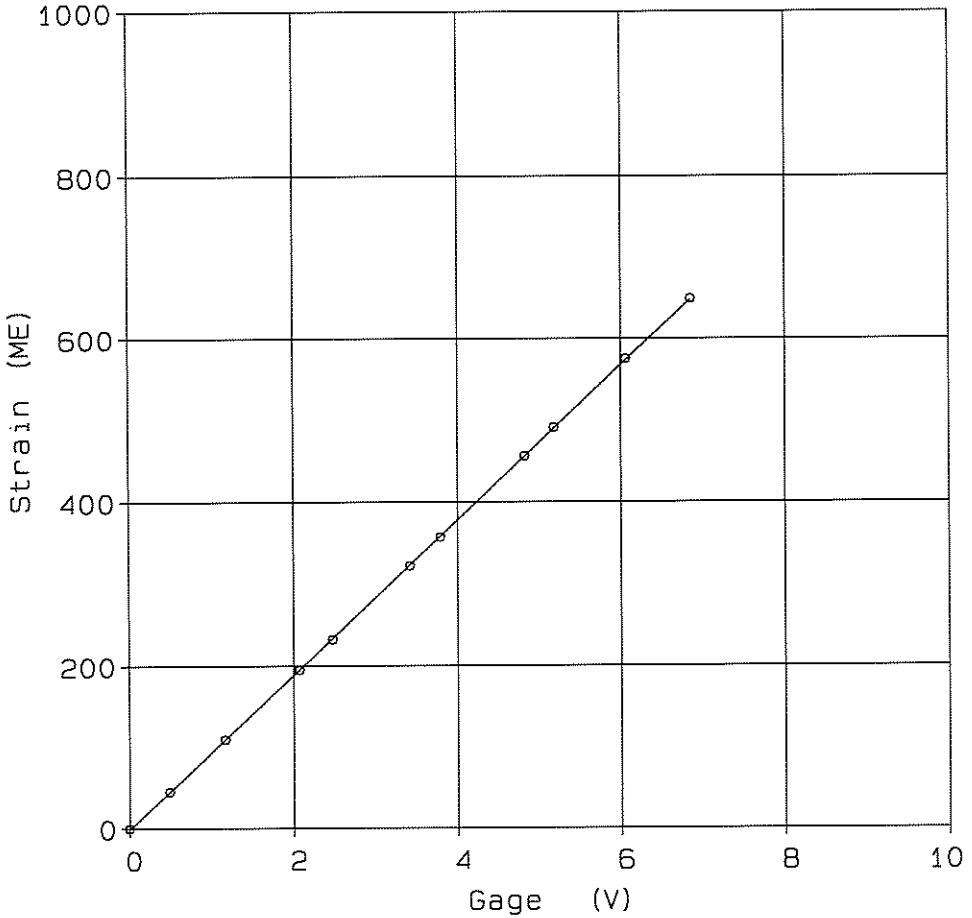

PDA Cal Factor = 94.9 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 329.5 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
46	.50
110	1.18
196	2.08
232	2.48
322	3.42
358	3.80
456	4.82
491	5.19
575	6.07
650	6.85

Calibrated by: J. S. Tsuchiroff

Calibrated on: 27-Feb-96

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2