Pile Dynamics, Inc.
Transducer 126I

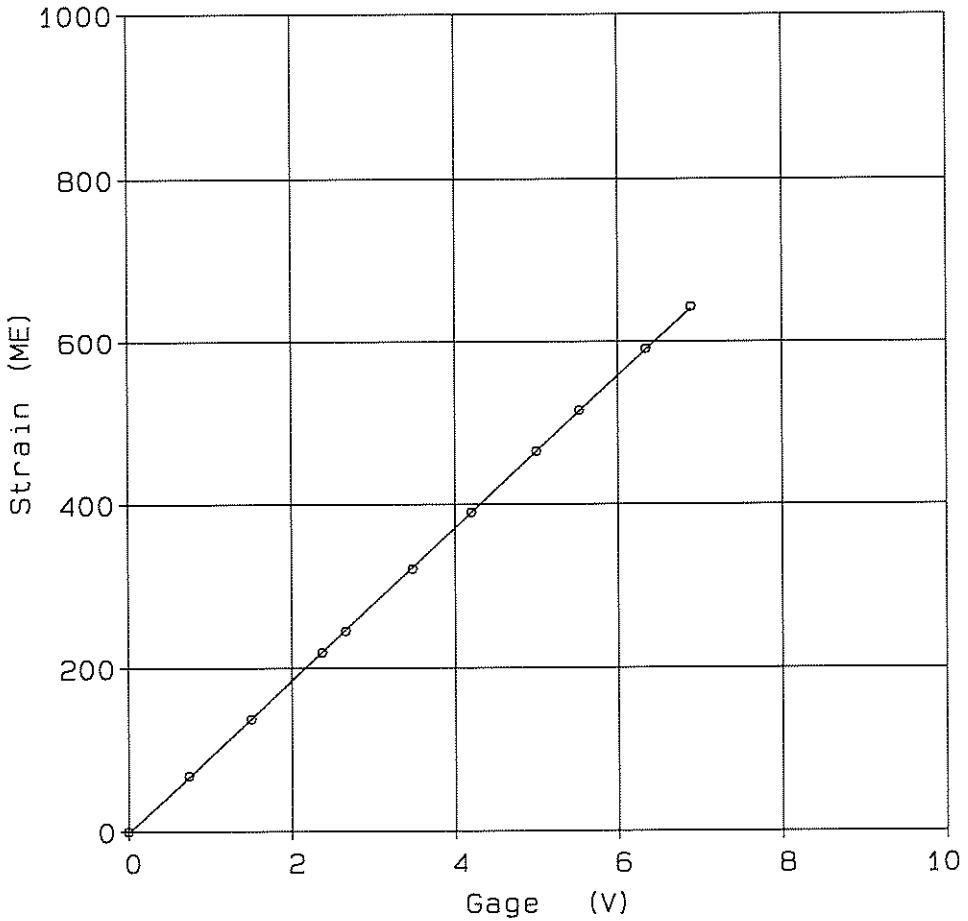

PDA Cal Factor = 93.4 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 324.3 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
69	.75
138	1.51
220	2.38
245	2.67
322	3.49
390	4.21
465	5.01
516	5.54
592	6.34
643	6.89

Calibrated by: J. Deutschendorf

Calibrated on: 27-Feb-96

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2