Pile Dynamics, Inc.
Transducer 128I

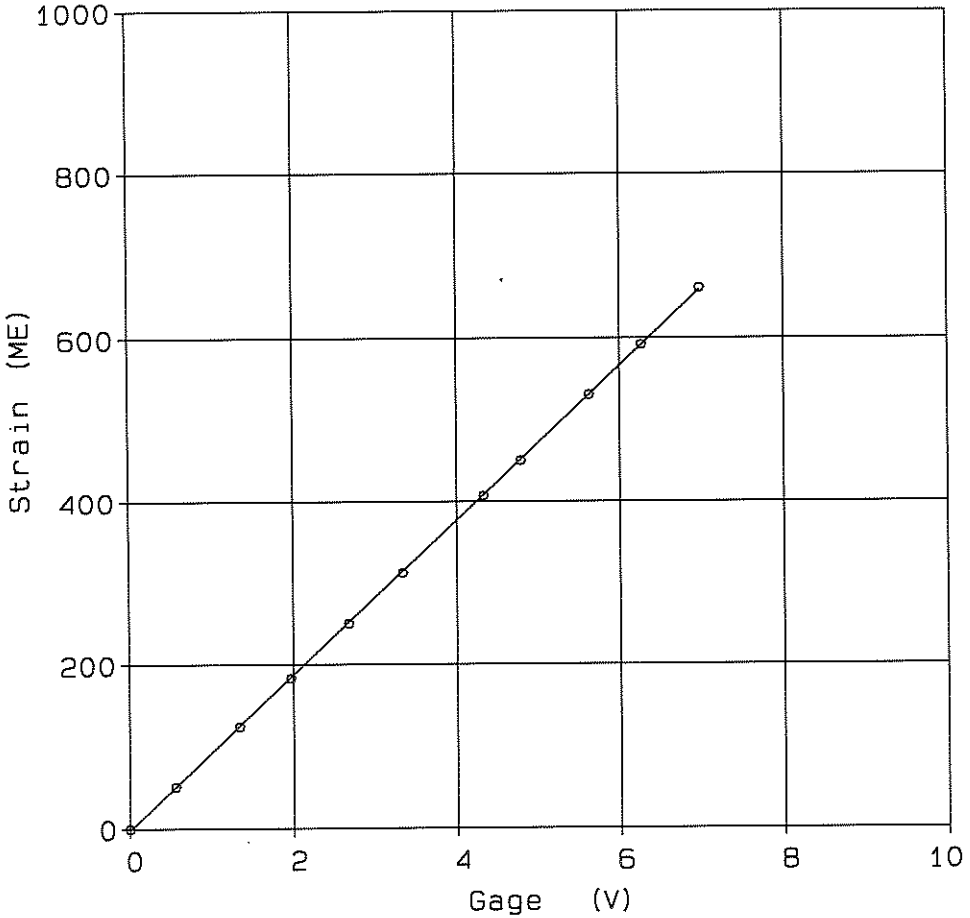

PDA Cal Factor = 94.7 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 328.9 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
51	.56
125	1.35
183	1.97
251	2.69
313	3.35
407	4.33
451	4.80
532	5.64
592	6.28
661	6.98

Calibrated by: Jim Stanford

Calibrated on: 19-Oct-94

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2