Pile Dynamics Inc
Transducer 130I

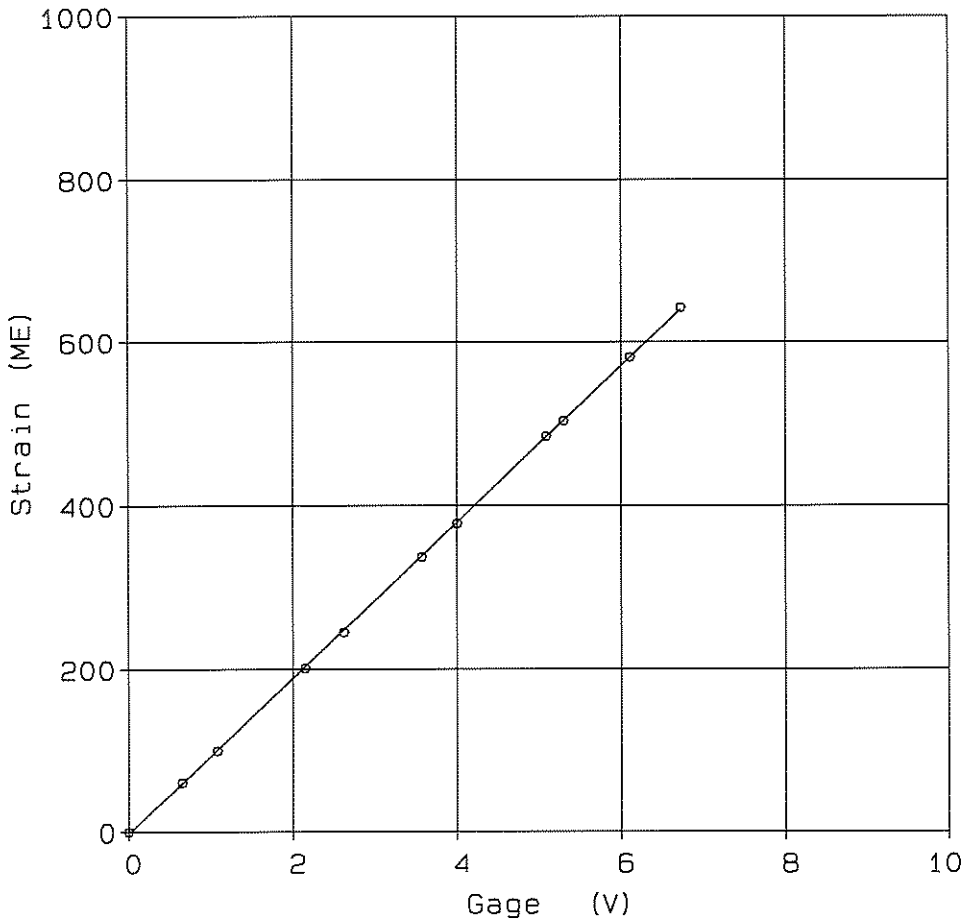

PDA Cal Factor = 95.4 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 331.4 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
62	.66
100	1.08
202	2.16
245	2.62
338	3.57
378	4.01
484	5.10
503	5.30
581	6.11
643	6.74

Calibrated by: J. Deutschaff

Calibrated on: 04-Sep-98

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2