Pile Dynamics, Inc.
Transducer 134I

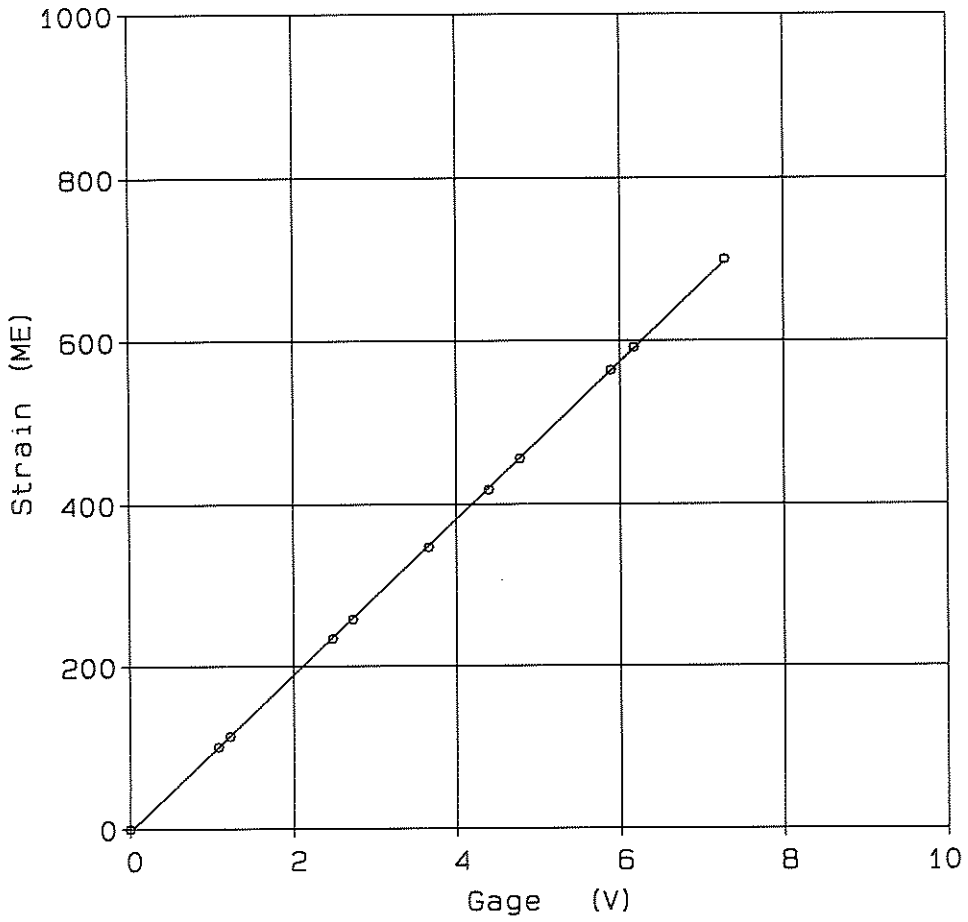

PDA Cal Factor = 96.3 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 334.4 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
101	1.09
115	1.22
235	2.49
258	2.74
347	3.66
419	4.40
456	4.78
565	5.90
593	6.18
700	7.28

Calibrated by: J. S. Tsuchiyoff

Calibrated on: 18-Aug-96

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2