Pile Dynamics, Inc.
Transducer 142I

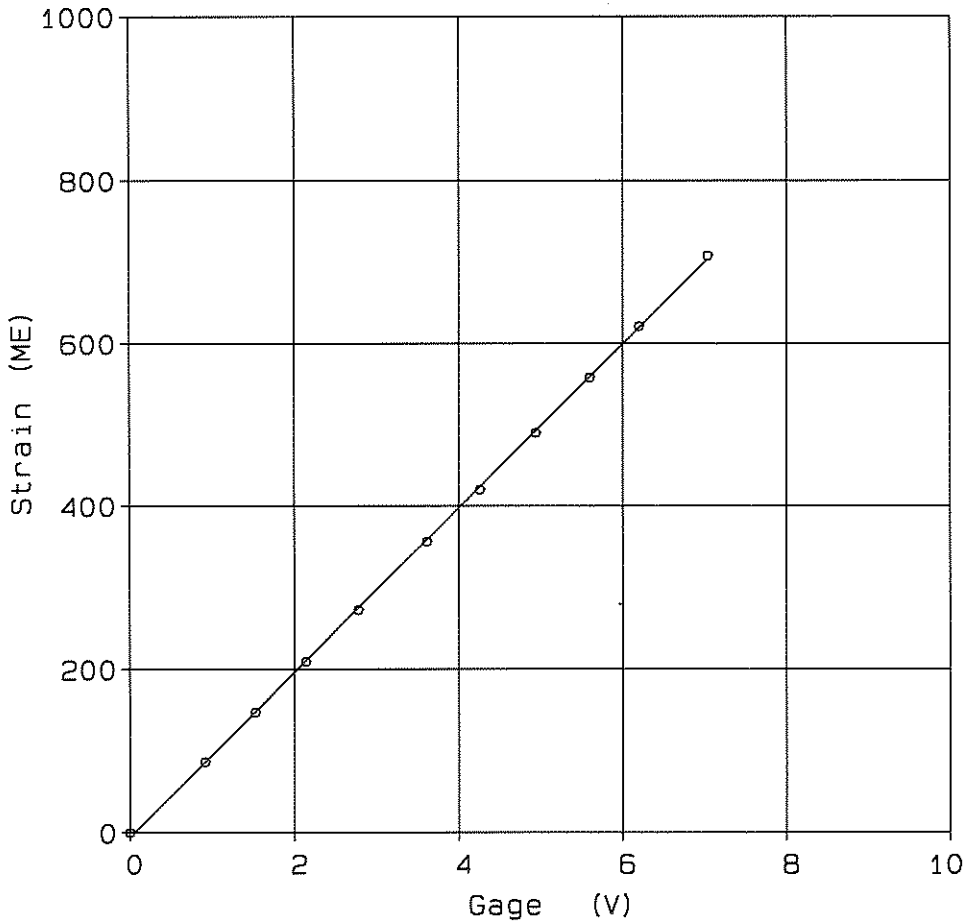

PDA Cal Factor = 100.8 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 349.9 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
88	.91
147	1.53
209	2.14
273	2.79
356	3.62
421	4.26
491	4.94
559	5.61
621	6.20
709	7.04

Calibrated by: Joe Bruno

Calibrated on: 23-Jun-95

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2