Pile Dynamics, Inc.
Transducer 148I

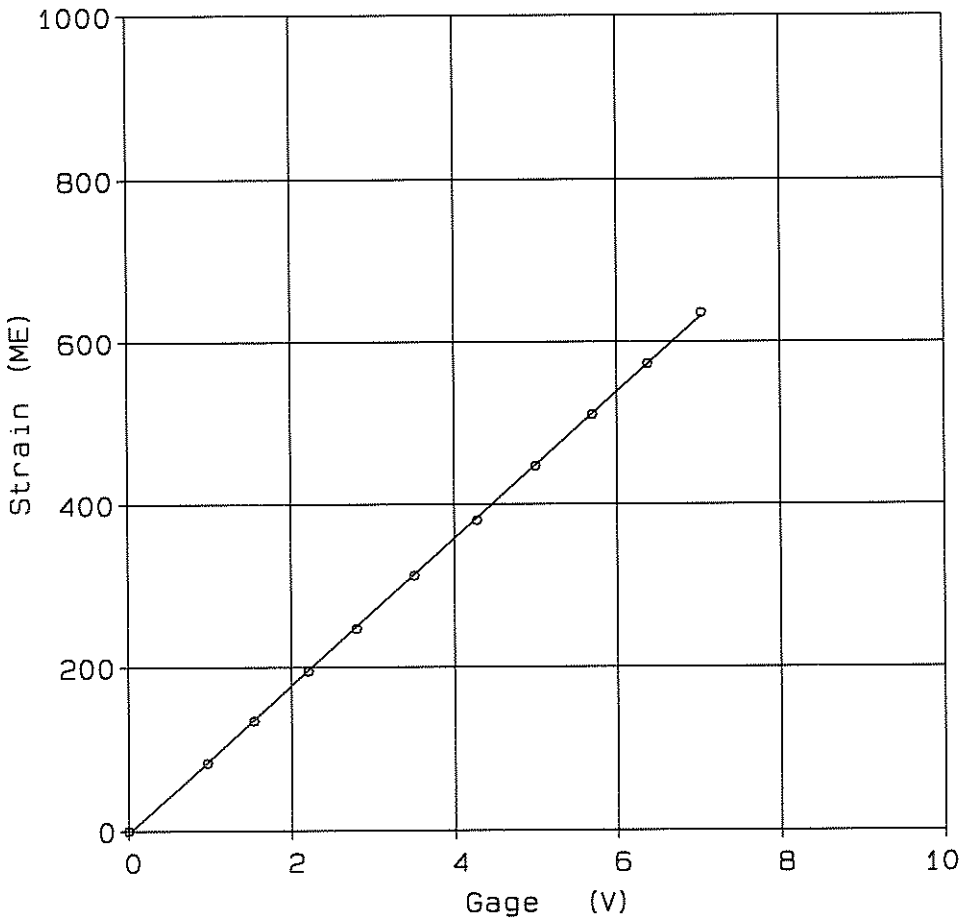

PDA Cal Factor	=	90.3 ME/V
Shunt (60.4KO)	=	5.0 V
General Factor	=	313.5 ME/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
85	.97
135	1.54
195	2.22
248	2.80
312	3.52
381	4.28
447	5.01
510	5.70
574	6.38
636	7.05

Calibrated by: Joe Bruno

Calibrated on: 06-Jul-95

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2