Pile Dynamics, Inc.

Transducer 149I

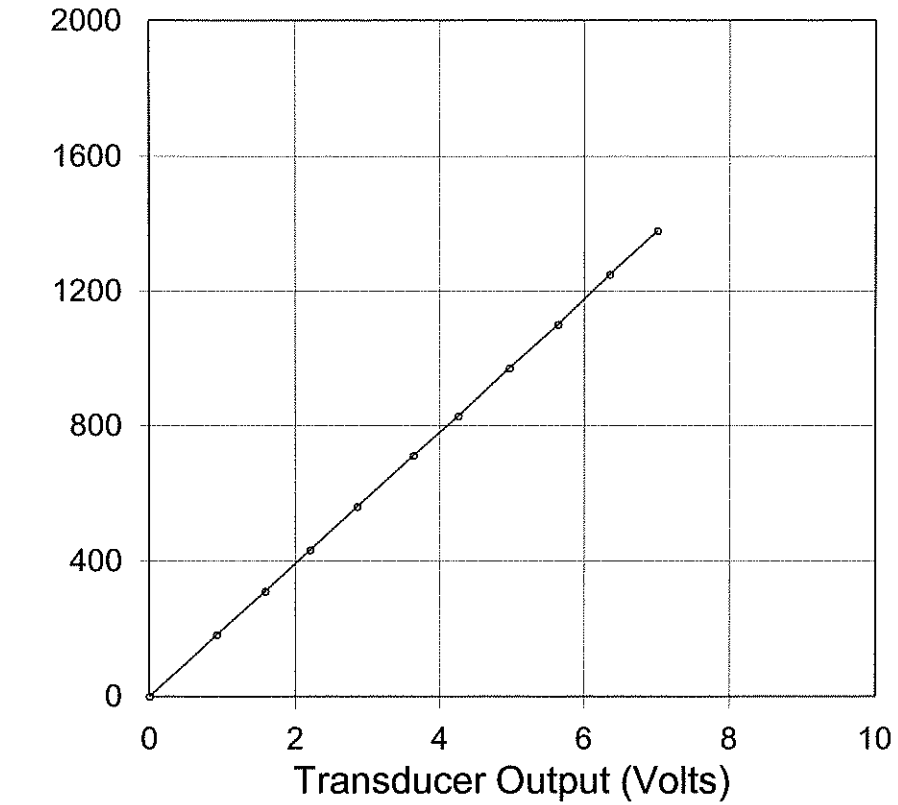

PDA Cal Factor (5.0 V) 98.1με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
184	0.91
311	1.58
431	2.20
558	2.85
711	3.63
829	4.25
972	4.96
1101	5.63
1251	6.35
1380	7.01

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 340.6με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by:

Calibrated on: 24-May-2010

Strain Transducer Calibrator System 2009 Version 1.3