Pile Dynamics Inc
Transducer 150I

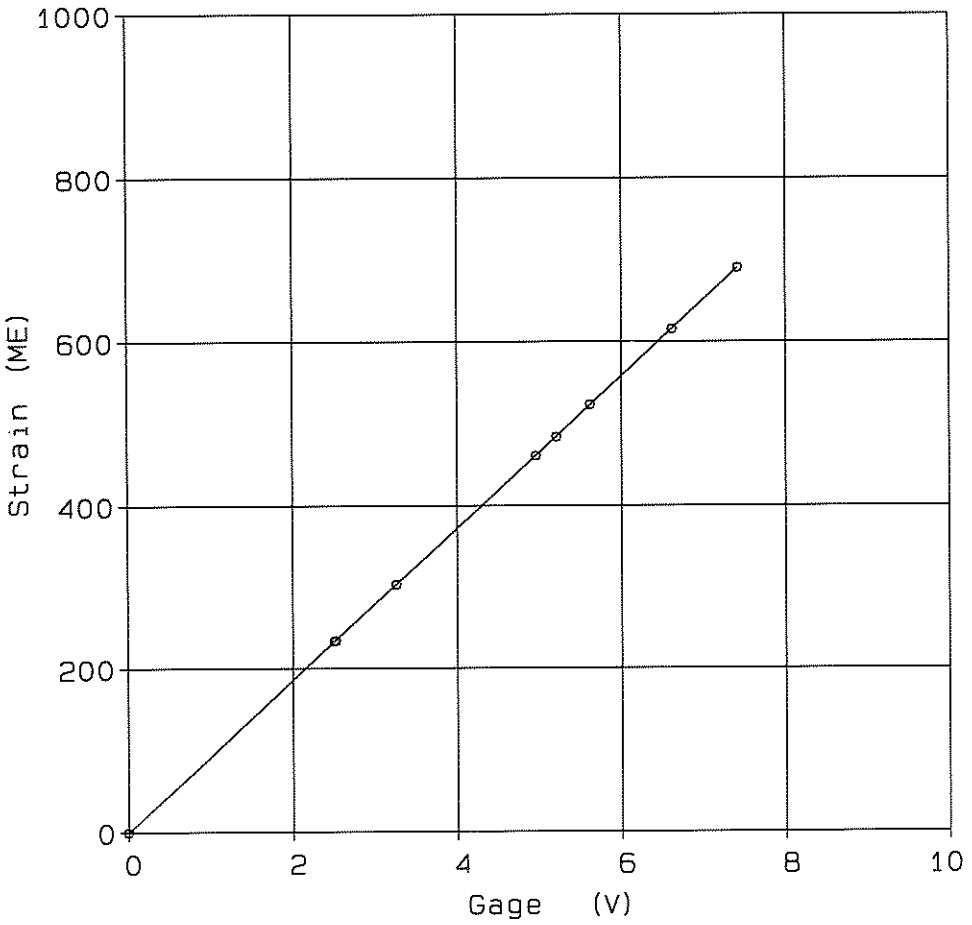

PDA Cal Factor = 93.1 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 323.1 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
234	2.53
235	2.53
233	2.51
233	2.52
304	3.27
461	4.97
484	5.21
524	5.63
616	6.62
690	7.43

Calibrated by: J. Rentschler

Calibrated on: 14-Feb-00

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2