Pile Dynamics, Inc.
Transducer 154I

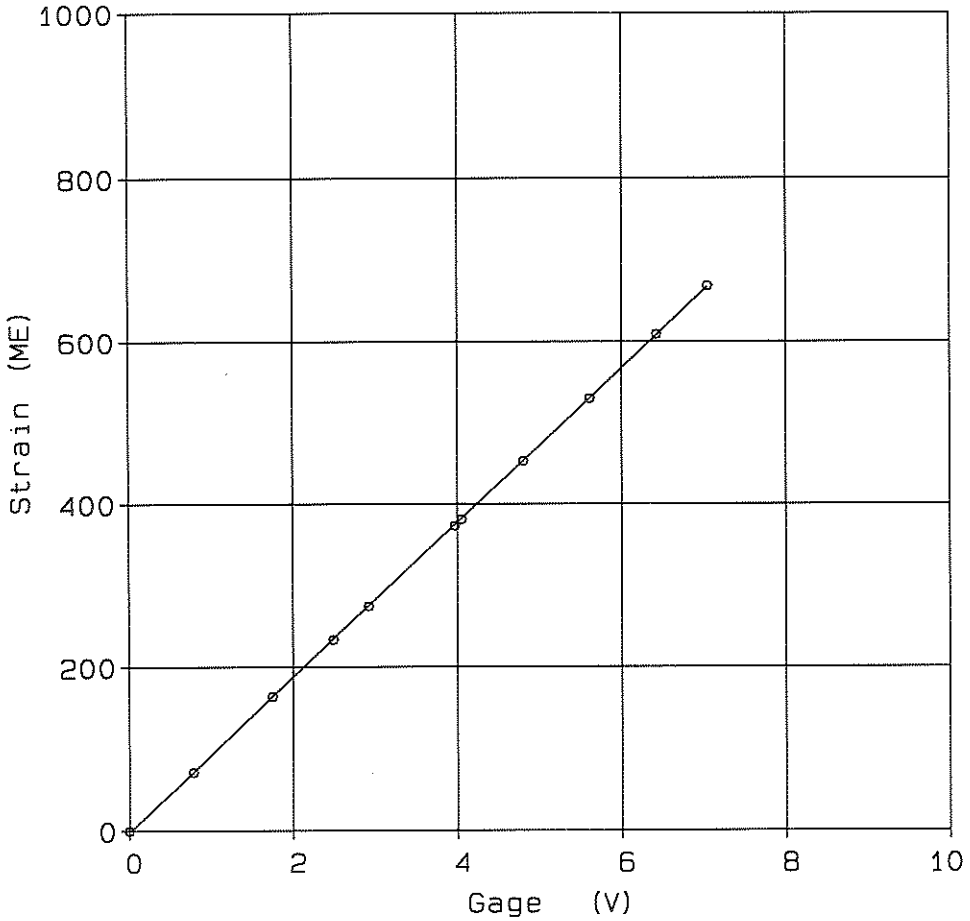

PDA Cal Factor	=	94.8 ME/V
Shunt (60.4KO)	=	5.0 V
General Factor	=	329.2 ME/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
73	.78
164	1.76
234	2.50
274	2.92
373	3.97
381	4.05
453	4.81
530	5.61
610	6.44
668	7.06

Calibrated by: J.S. Rausbach

Calibrated on: 05-Nov-96

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2