Pile Dynamics, Inc.

Transducer 156I

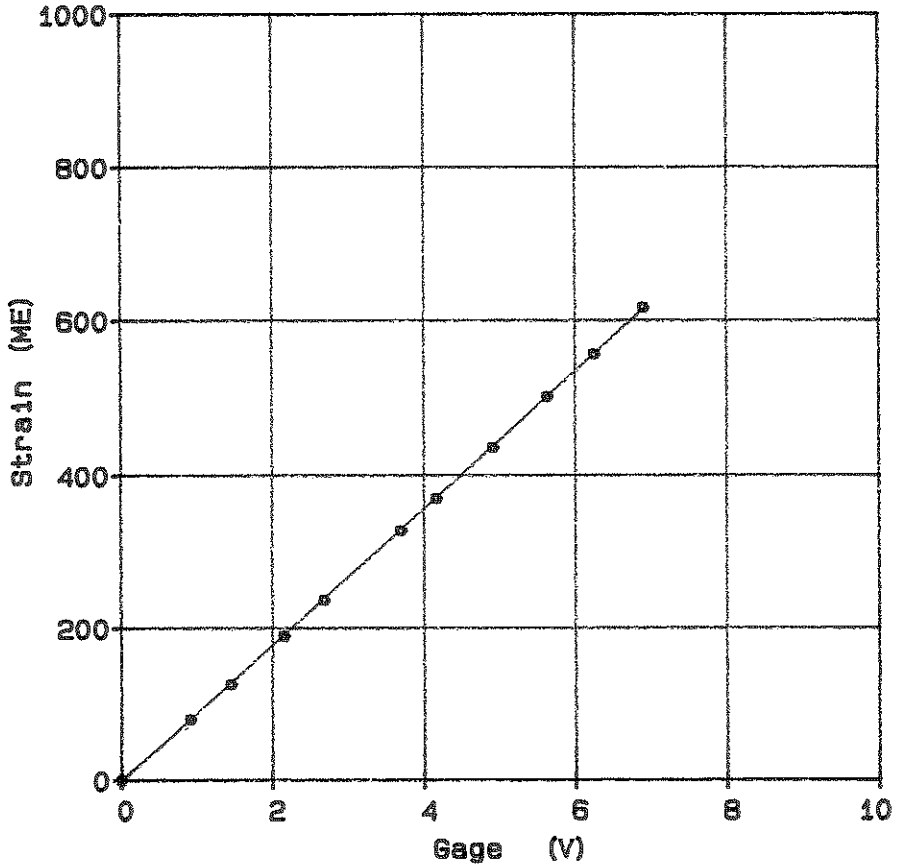

PDA Cal Factor = 89.3 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 310.1 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
81	.91
127	1.45
190	2.15
237	2.68
328	3.70
370	4.17
436	4.91
502	5.64
557	6.26
617	6.91

Calibrated by: _____

Calibrated on: 27-May-94

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2