Pile Dynamics, Inc.
Transducer 158I

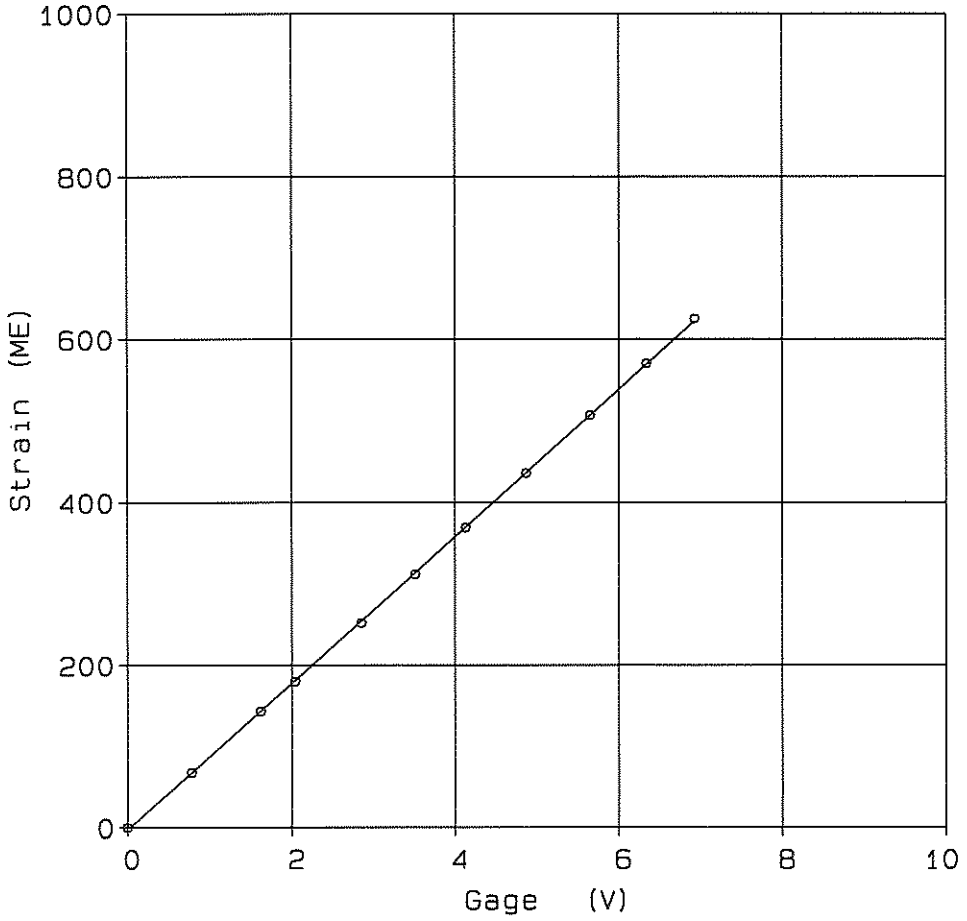

PDA Cal Factor = 90.2 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 313.4 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
68	.78
144	1.63
181	2.05
253	2.85
313	3.52
369	4.14
436	4.88
507	5.66
571	6.34
625	6.93

Calibrated by: Joe Berus

Calibrated on: 27-Jun-95

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2