Pile Dynamics Inc
Transducer 163I

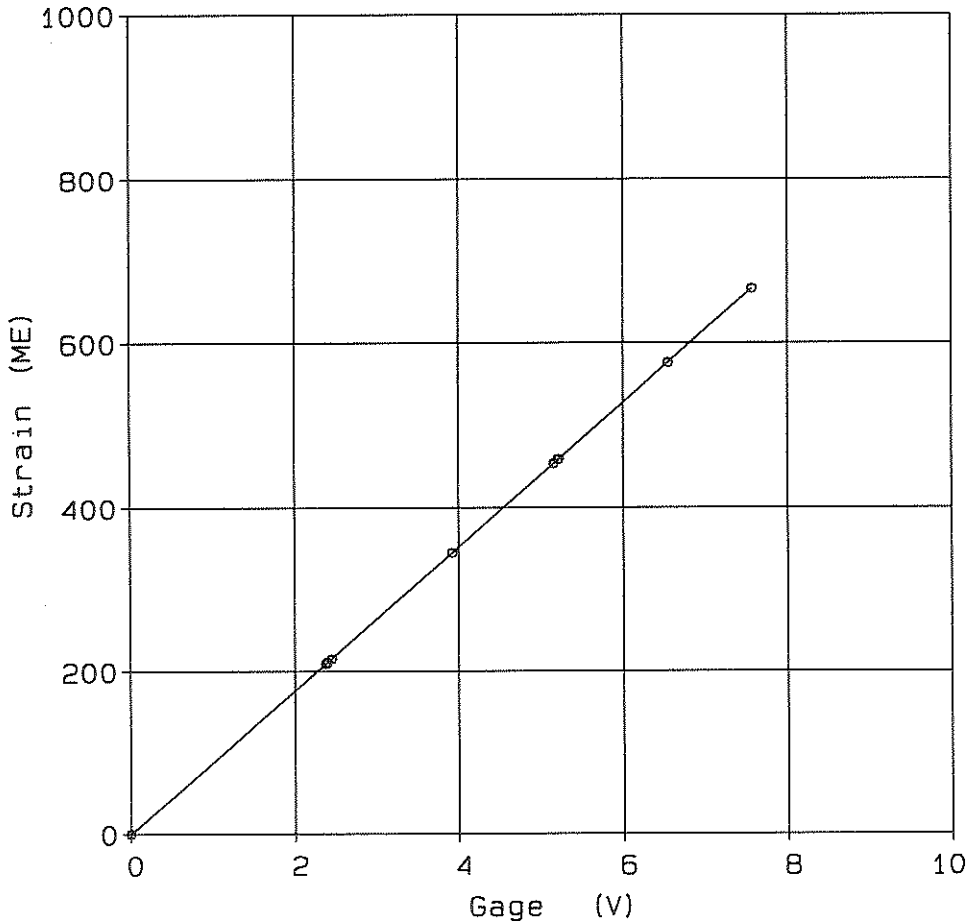

PDA Cal Factor = 88.0 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 305.7 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
211	2.41
209	2.38
210	2.39
216	2.46
345	3.93
459	5.21
454	5.16
460	5.22
577	6.56
667	7.57

Calibrated by: J. Rausch

Calibrated on: 23-Aug-00

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2