Pile Dynamics, Inc.
Transducer 167I

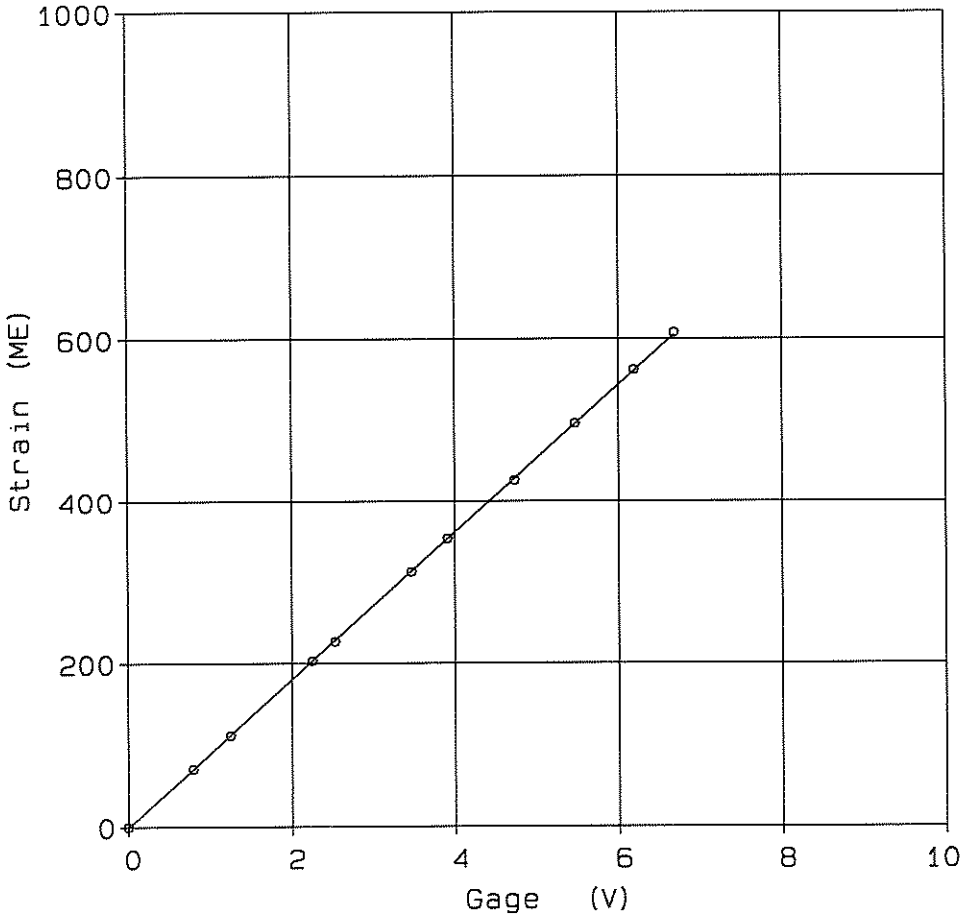

PDA Cal Factor = 90.9 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 315.7 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
71	.79
112	1.26
204	2.26
227	2.54
314	3.48
354	3.92
427	4.73
496	5.48
562	6.20
608	6.68

Calibrated by: J. Peukett

Calibrated on: 04-Aug-96

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2