Pile Dynamics, Inc.
Transducer 170I

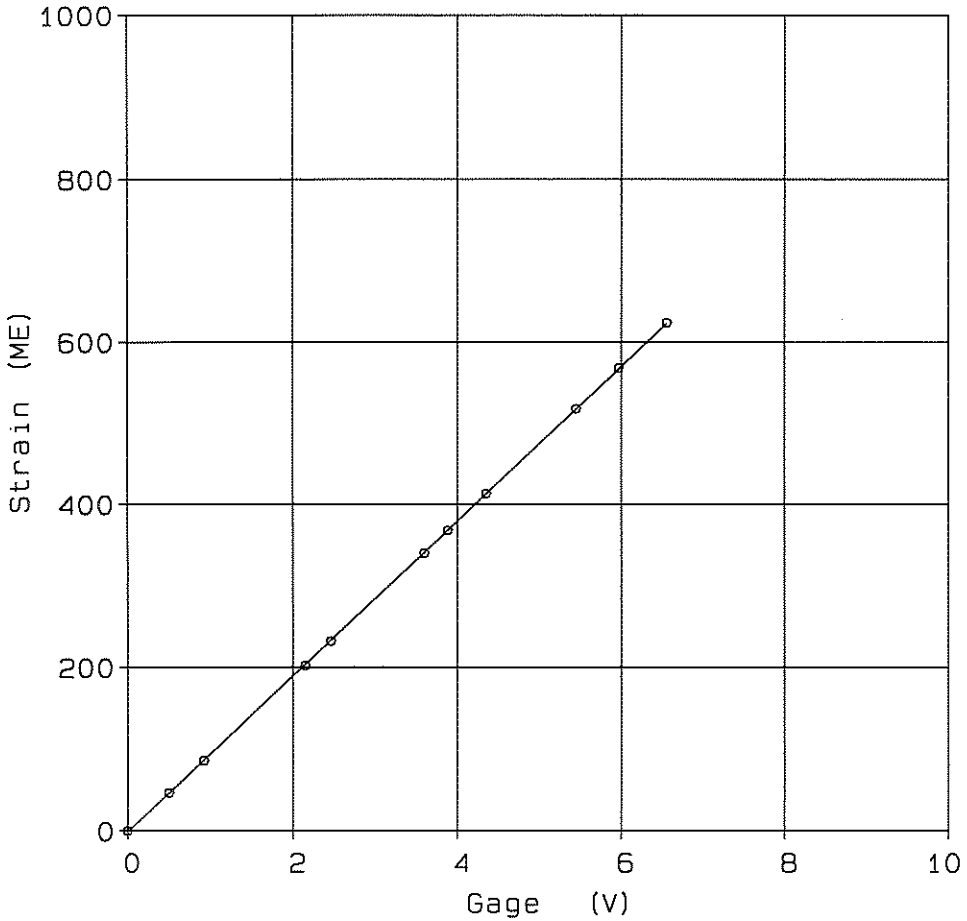

PDA Cal Factor	=	95.3 ME/V
Shunt (60.4KO)	=	5.0 V
General Factor	=	330.9 ME/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
48	.51
87	.93
203	2.15
232	2.47
341	3.59
369	3.89
413	4.36
518	5.45
569	5.98
624	6.56

Calibrated by: J. Sterbutaff

Calibrated on: 09-Aug-96

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2