Pile Dynamics, Inc.

Transducer 171I

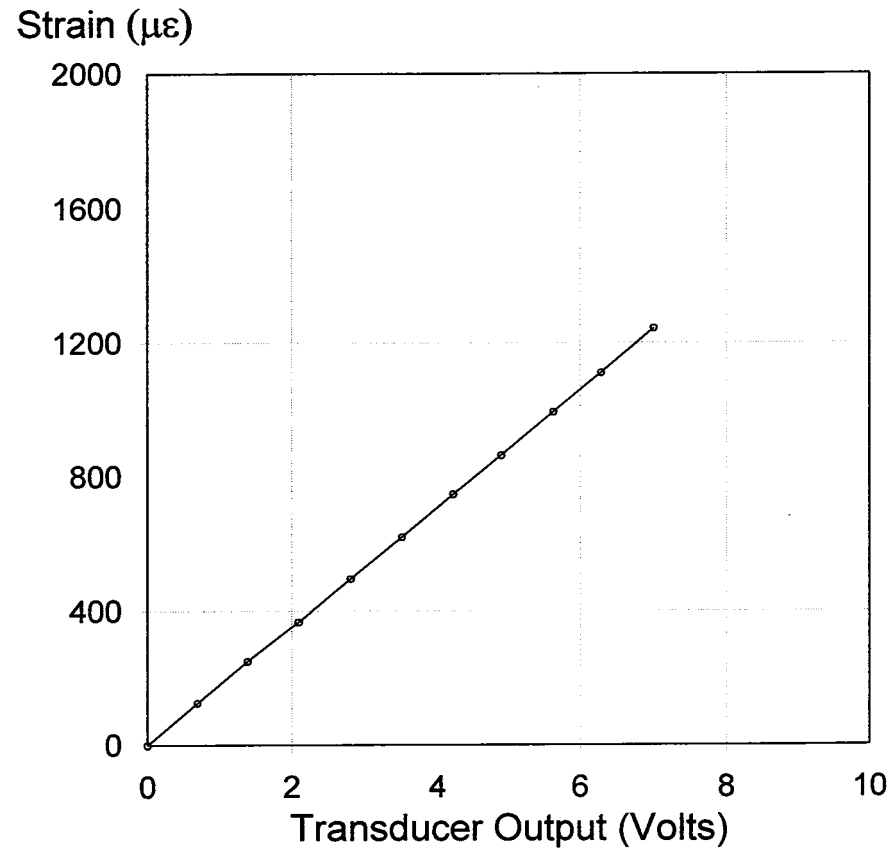

PDA Cal Factor (5.0 V) 88.4με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
126	0.70
250	1.40
367	2.09
495	2.80
617	3.50
745	4.22
863	4.89
992	5.62
1110	6.29
1244	7.01

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 306.9με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by:

Calibrated on: 01-Oct-2014

Strain Transducer Calibrator System 2011 Version 1.5