Pile Dynamics Inc

Transducer 173I

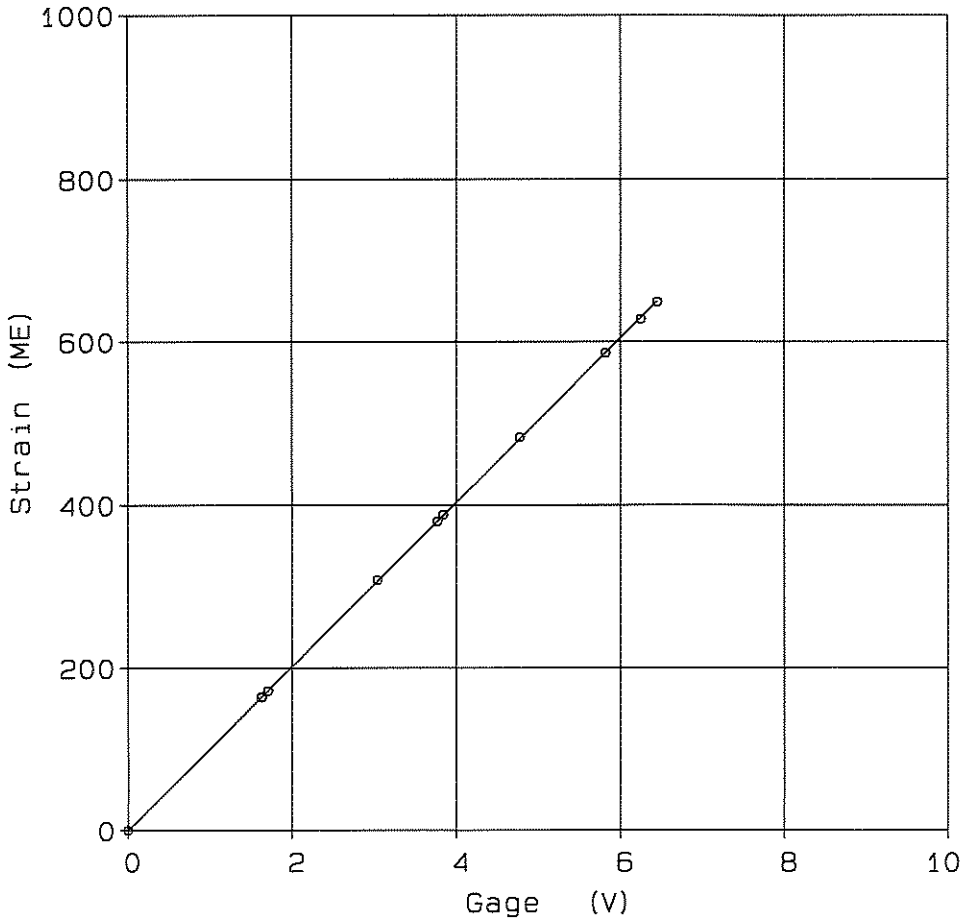

PDA Cal Factor = 100.6 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 349.4 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
166	1.65
164	1.63
173	1.71
309	3.05
381	3.78
389	3.85
484	4.78
586	5.82
628	6.25
650	6.45

Calibrated by: J. Deutsch

Calibrated on: 27-Sep-99

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2