Pile Dynamics Inc

Transducer 177I

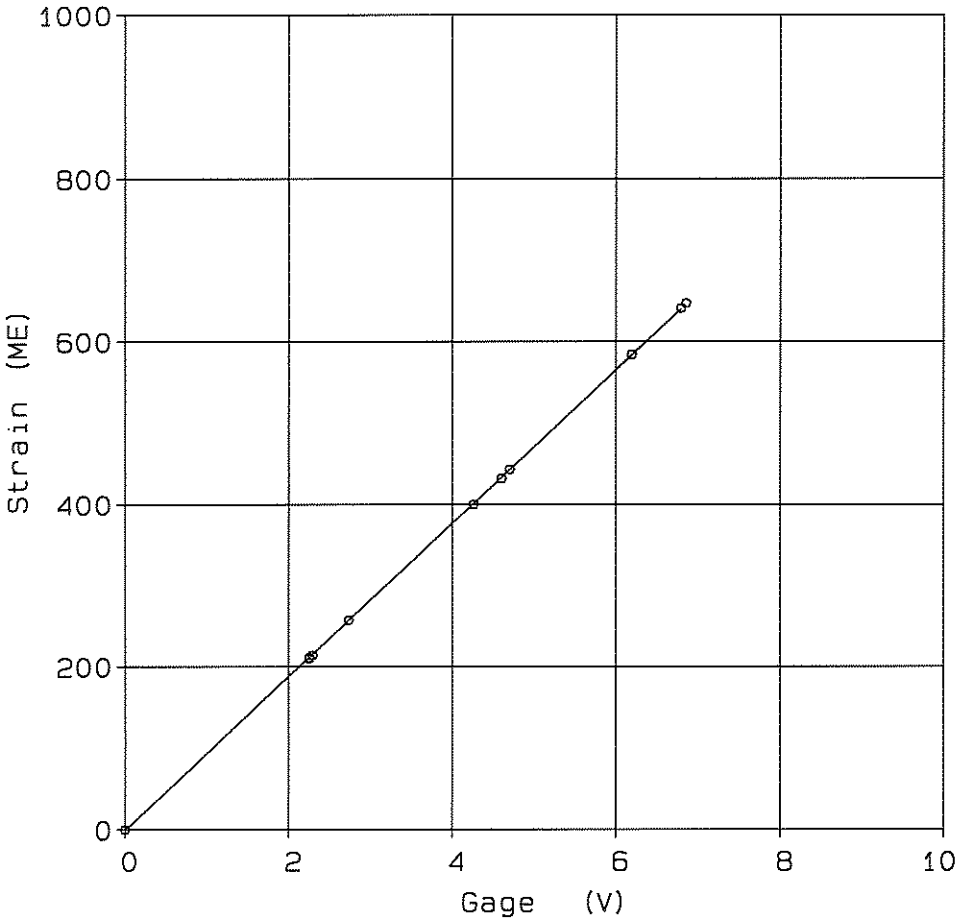

PDA Cal Factor	=	94.6 ME/V
Shunt (60.4KO)	=	5.0 V
General Factor	=	328.4 ME/mV/V

Strain ME	Gage V
0	.00
215	2.29
211	2.25
211	2.26
257	2.74
401	4.26
433	4.60
444	4.71
584	6.19
647	6.86
642	6.79

Calibrated by: _____

Calibrated on: 28-Nov-01

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2