Pile Dynamics Inc
Transducer 179I

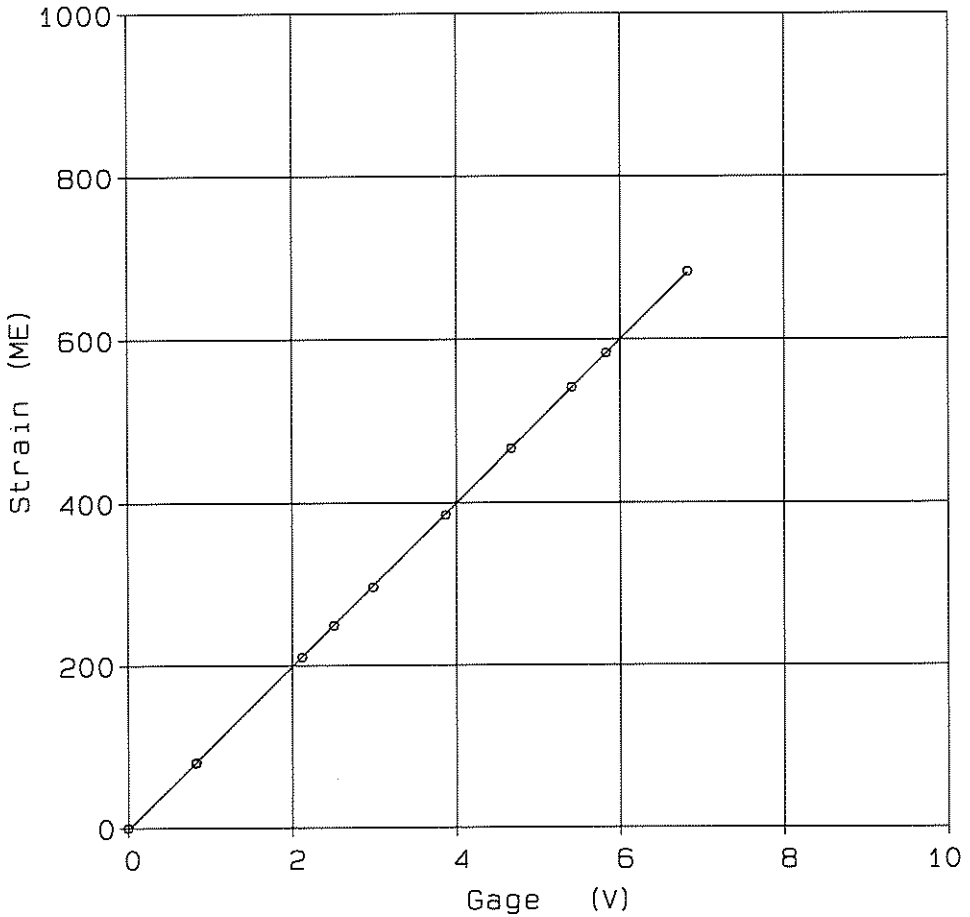

PDA Cal Factor = 100.3 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 348.3 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
82	.84
80	.82
210	2.13
249	2.51
296	2.99
386	3.87
466	4.67
541	5.42
583	5.83
683	6.82

Calibrated by: J. Pentkowski

Calibrated on: 05-Jun-98

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2