# Pile Dynamics Inc
# Transducer 181I

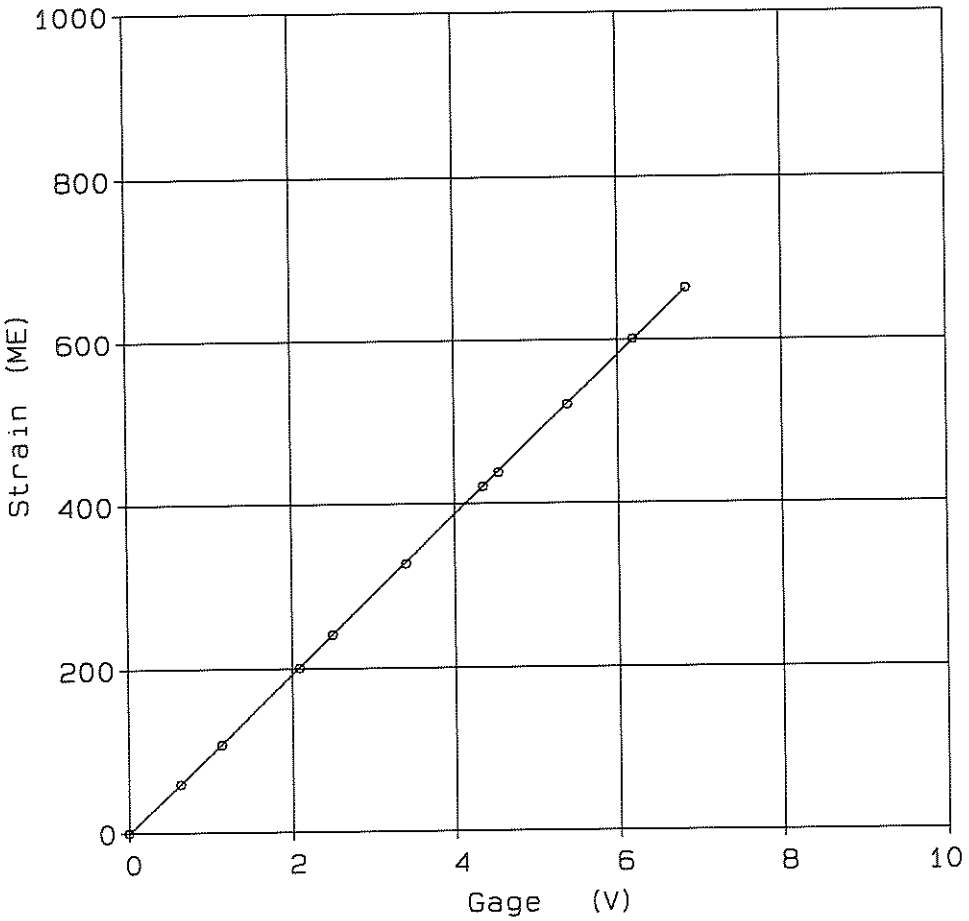


PDA Cal Factor = 97.1 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 337.2 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

| Strain ME | Gage V |
|---|---|
| 0 | .00 |
| 61 | .63 |
| 109 | 1.14 |
| 201 | 2.09 |
| 241 | 2.51 |
| 328 | 3.41 |
| 421 | 4.36 |
| 438 | 4.54 |
| 522 | 5.40 |
| 601 | 6.19 |
| 665 | 6.85 |

Calibrated by: J. Rowtoff

Calibrated on: 23-Jul-99

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2