Pile Dynamics Inc
Transducer 182I

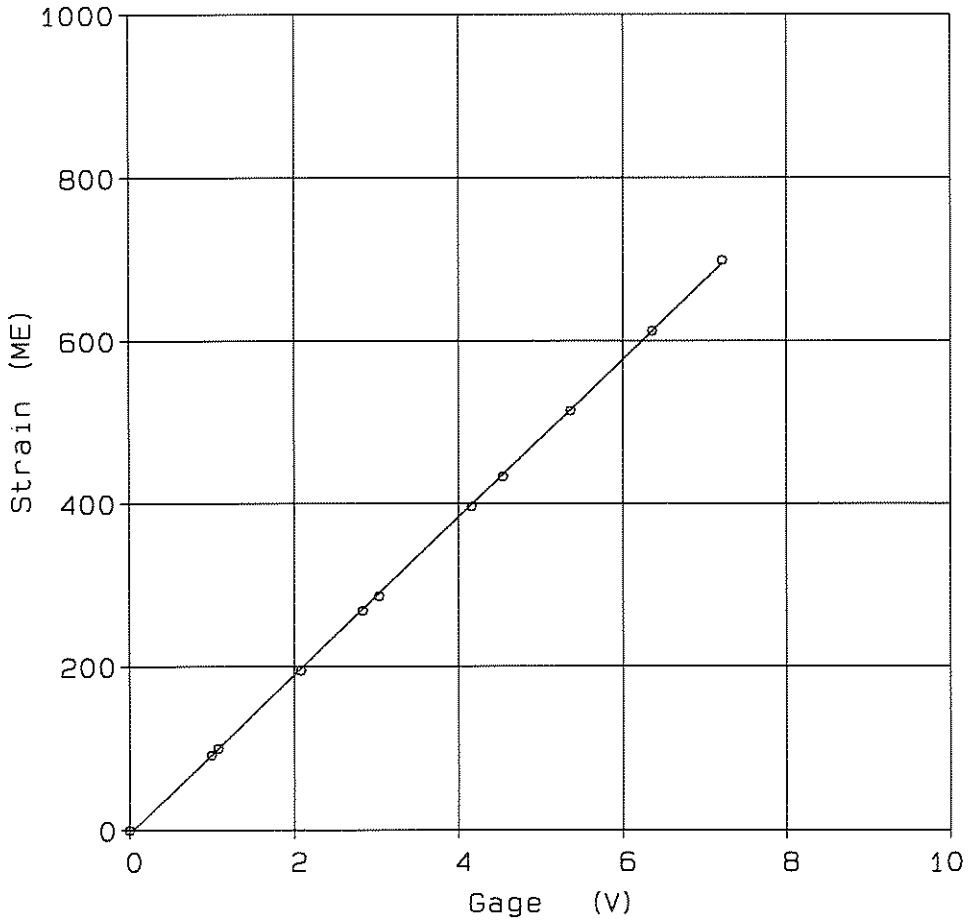

PDA Cal Factor = 96.8 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 336.0 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
93	1.00
100	1.07
195	2.08
268	2.84
287	3.03
396	4.16
434	4.55
514	5.36
612	6.36
699	7.23

Calibrated by: J. Deutchelf

Calibrated on: 25-Sep-98

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2