Pile Dynamics, Inc

Transducer 184 I

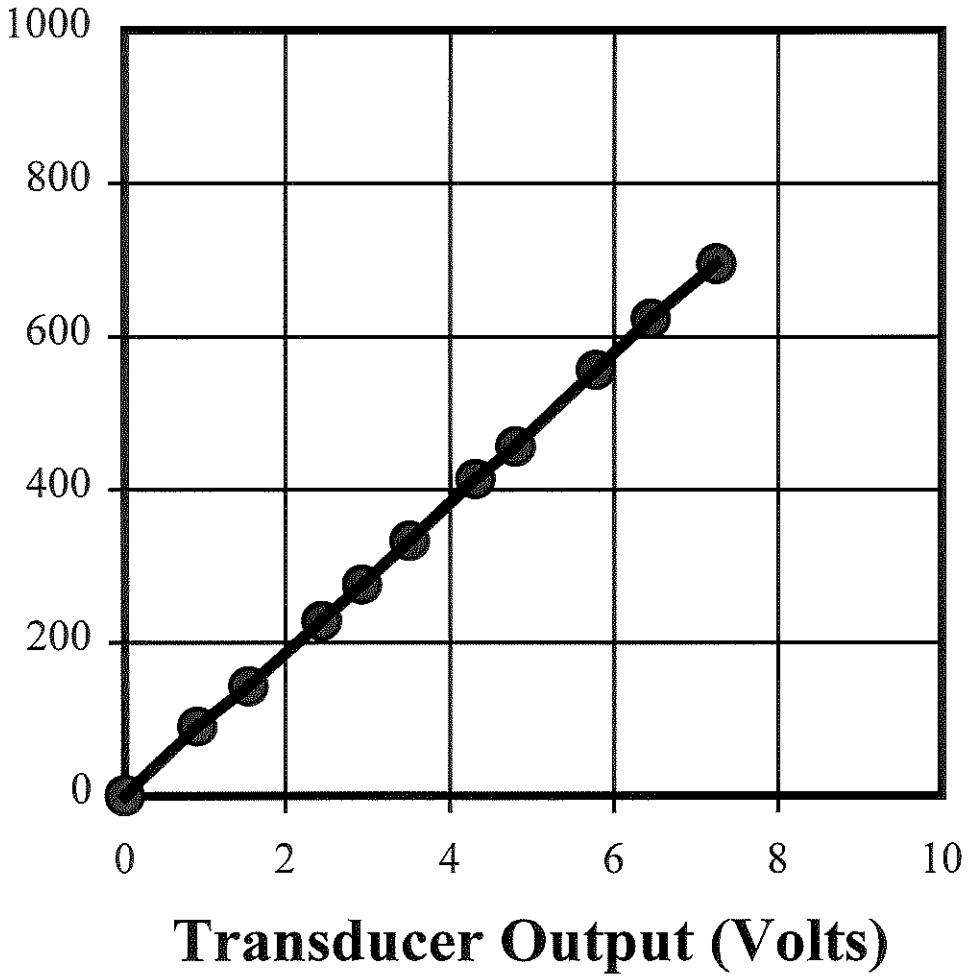

PDA Cal Factor	96.48με/V
Shunt(60.4 KΩ)	5.0 V
General Factor	335.00με/mV/V
Traceable to N.I.S.T.	

Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0.00	0.00
88.82	0.93
145.34	1.54
230.92	2.43
276.95	2.90
333.47	3.49
413.40	4.32
458.62	4.78
555.51	5.79
623.33	6.47
697.61	7.24

Calibrated by: B

Calibrated on: 30-Sep-2003

Strain Transducer Calibrator System 2003 Version 1