Pile Dynamics, Inc.
Transducer 187I

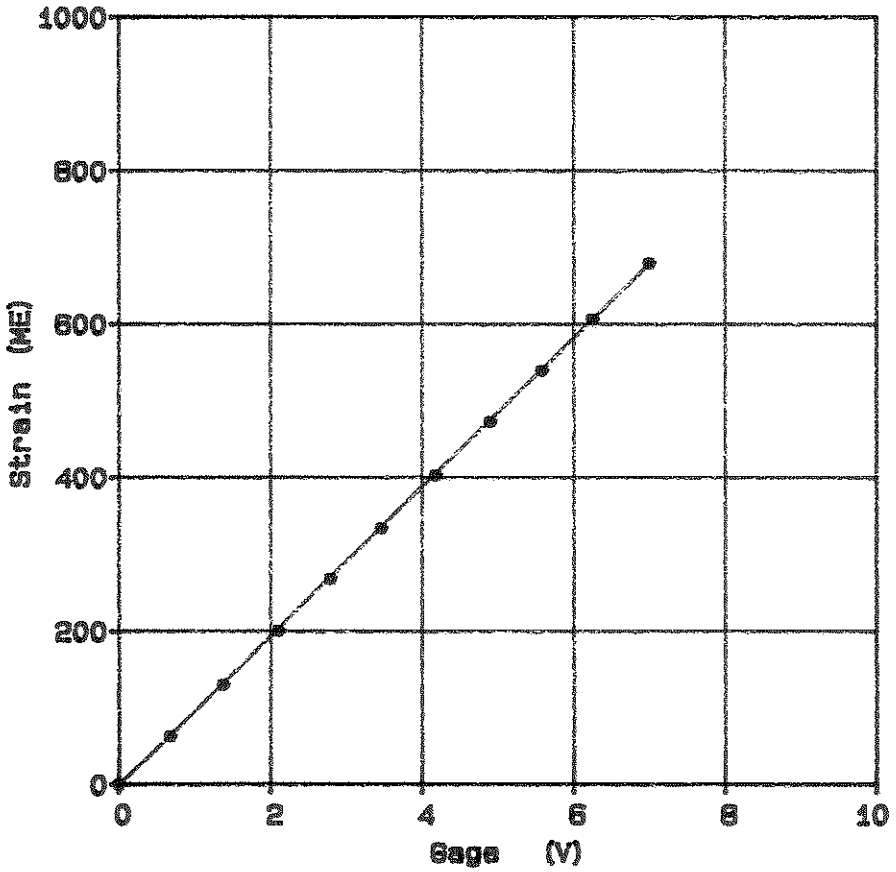

PDA Cal Factor	=	97.2 ME/V
Shunt (60.4KΩ)	=	5.0 V
General Factor	=	337.4 ME/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
65	.67
132	1.38
202	2.10
269	2.80
334	3.47
404	4.19
474	4.90
541	5.58
607	6.26
681	7.01

Calibrated by: Jane Bark

Calibrated on: 06-Jul-94

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2