Pile Dynamics, Inc.
Transducer 188I

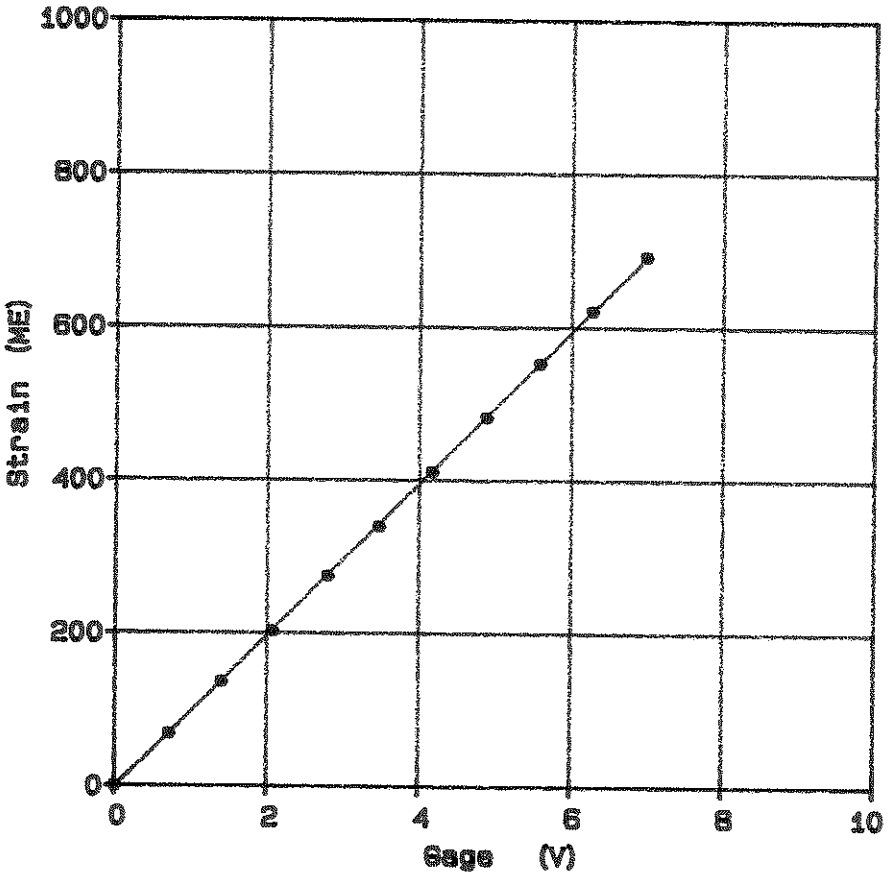

PDA Cal Factor	=	99.3 ME/V
Shunt (60.4KΩ)	=	5.0 V
General Factor	=	344.9 ME/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
69	.71
137	1.40
203	2.08
275	2.81
341	3.47
411	4.18
482	4.88
553	5.59
622	6.28
693	6.99

Calibrated by: _____

Calibrated on: 05-Jul-94

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2