Pile Dynamics, Inc.

Transducer 189I

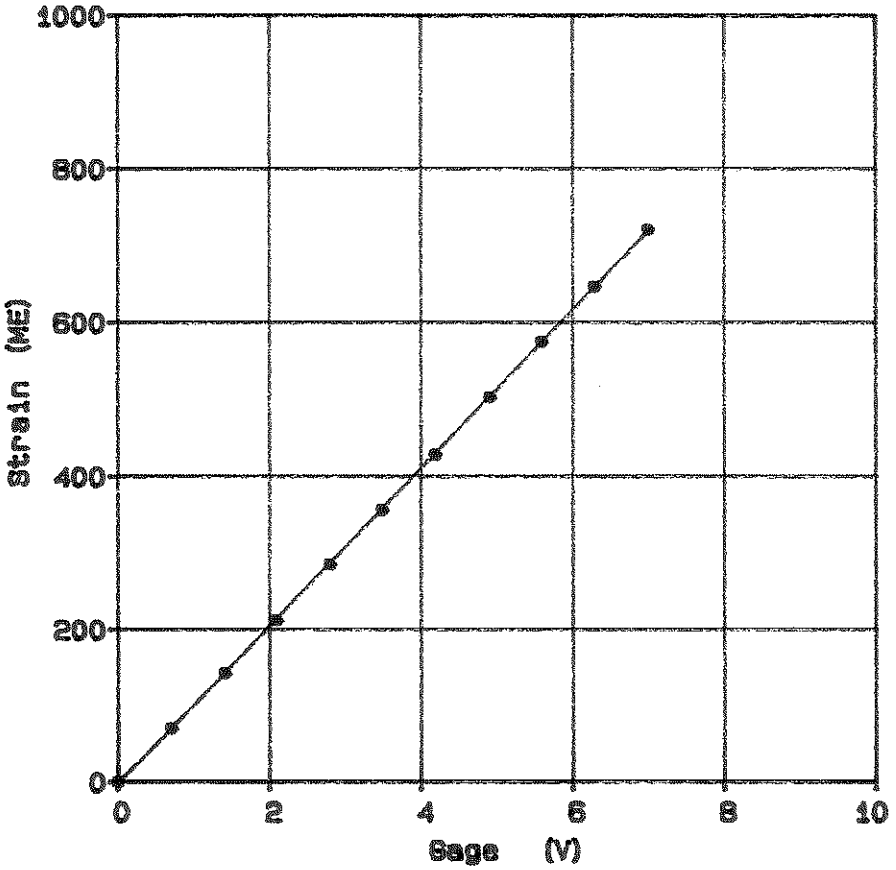

PDA Cal Factor = 103.1 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 358.0 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
71	.70
143	1.41
213	2.10
285	2.81
357	3.50
429	4.19
504	4.91
575	5.60
648	6.30
722	7.00

Calibrated by: _____

Calibrated on: 06-Jul-94

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2