# Pile Dynamics, Inc.
# Transducer 190I

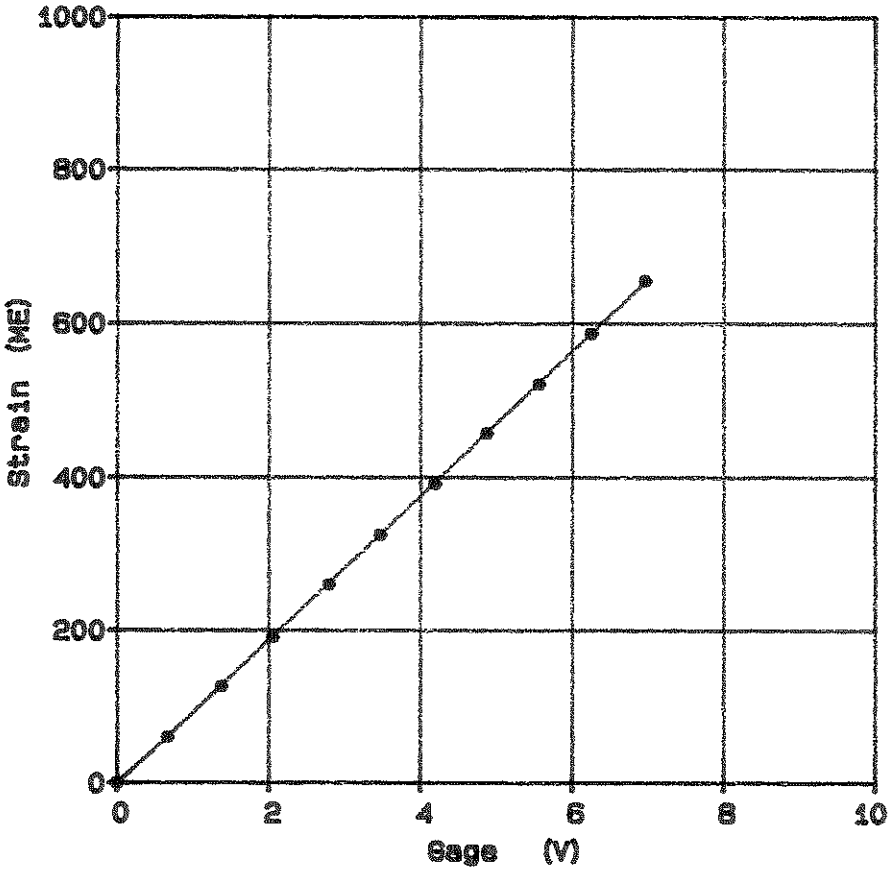


| | | |
|---|---|---|
| PDA Cal Factor | = | 94.2 ME/V |
| Shunt (60.4KΩ) | = | 5.0 V |
| General Factor | = | 327.0 ME/mV/V |

Traceable to N.I.S.T.

| Strain ME | Gage V |
|---|---|
| 0 | .00 |
| 62 | .67 |
| 127 | 1.38 |
| 191 | 2.06 |
| 260 | 2.79 |
| 325 | 3.48 |
| 393 | 4.20 |
| 457 | 4.88 |
| 522 | 5.56 |
| 588 | 6.25 |
| 656 | 6.97 |

Calibrated by: Jan Bork

Calibrated on: 05-Jul-94

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2