Pile Dynamics, Inc.
Transducer 192I

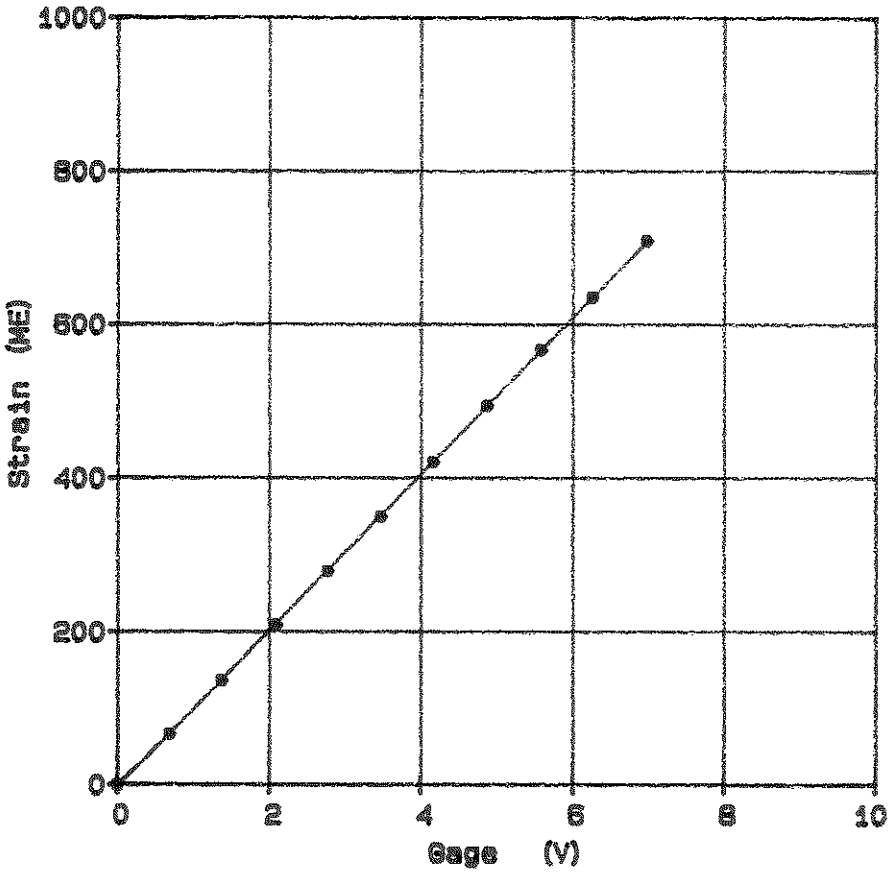

PDA Cal Factor	=	101.9 ME/V
Shunt (60.4KΩ)	=	5.0 V
General Factor	=	353.8 ME/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
68	.68
137	1.37
210	2.09
280	2.77
350	3.47
421	4.16
494	4.88
567	5.59
636	6.26
711	6.98

Calibrated by: Jason Berk

Calibrated on: 06-Jul-94

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2