Pile Dynamics, Inc.

Transducer 200W

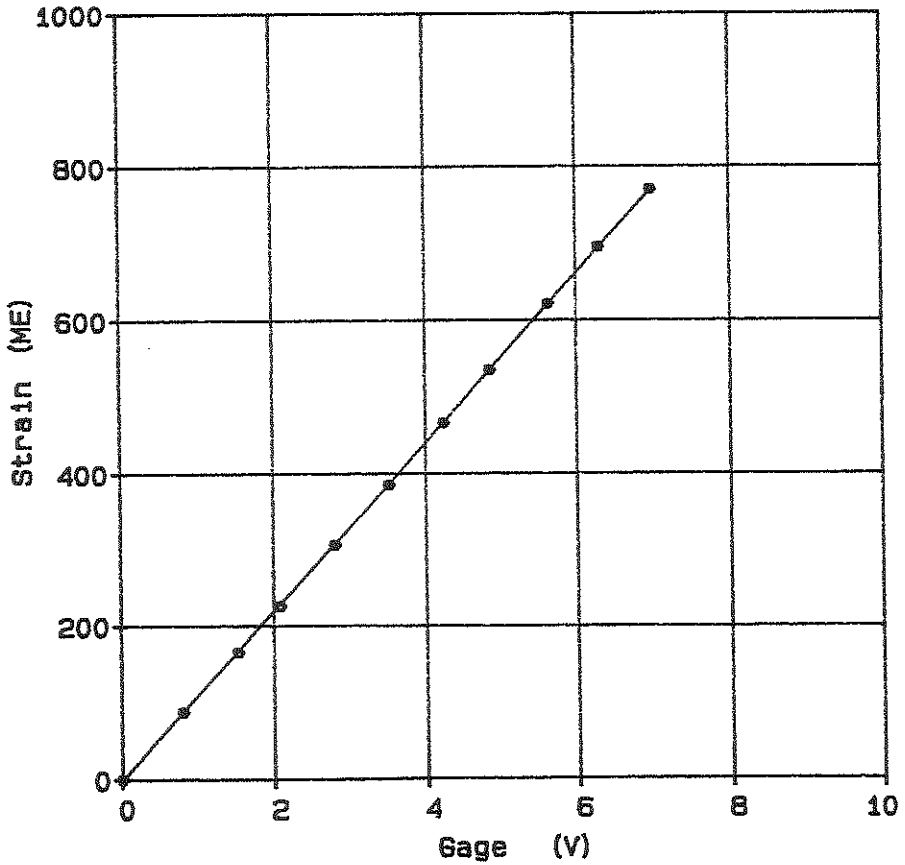

PDA Cal Factor = 110.5 ME/V
Shunt (60.4KΩ) = 5.0 V

General Factor = 383.8 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
88	.81
167	1.53
227	2.08
307	2.81
386	3.52
466	4.24
535	4.86
622	5.64
695	6.30
771	6.98

Calibrated by: Greg Jenth

Calibrated on: 22-Jul-94

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2