Pile Dynamics, Inc.

Transducer 201W

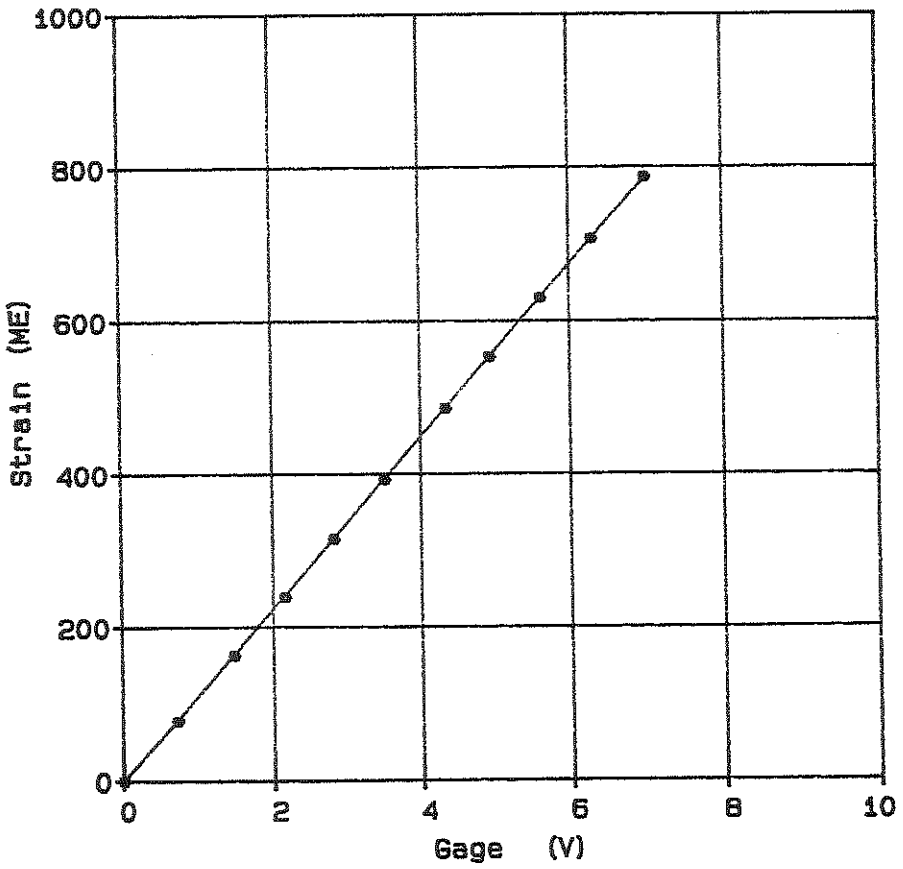

PDA Cal Factor = 112.5 ME/V
Shunt (60.4KΩ) = 5.0 V

General Factor = 390.7 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
79	.71
164	1.48
239	2.15
316	2.83
393	3.52
486	4.34
553	4.93
631	5.62
708	6.30
788	7.01

Calibrated by: Greg Jenh

Calibrated on: 22-Jul-94

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2