Pile Dynamics, Inc.
Transducer 203W

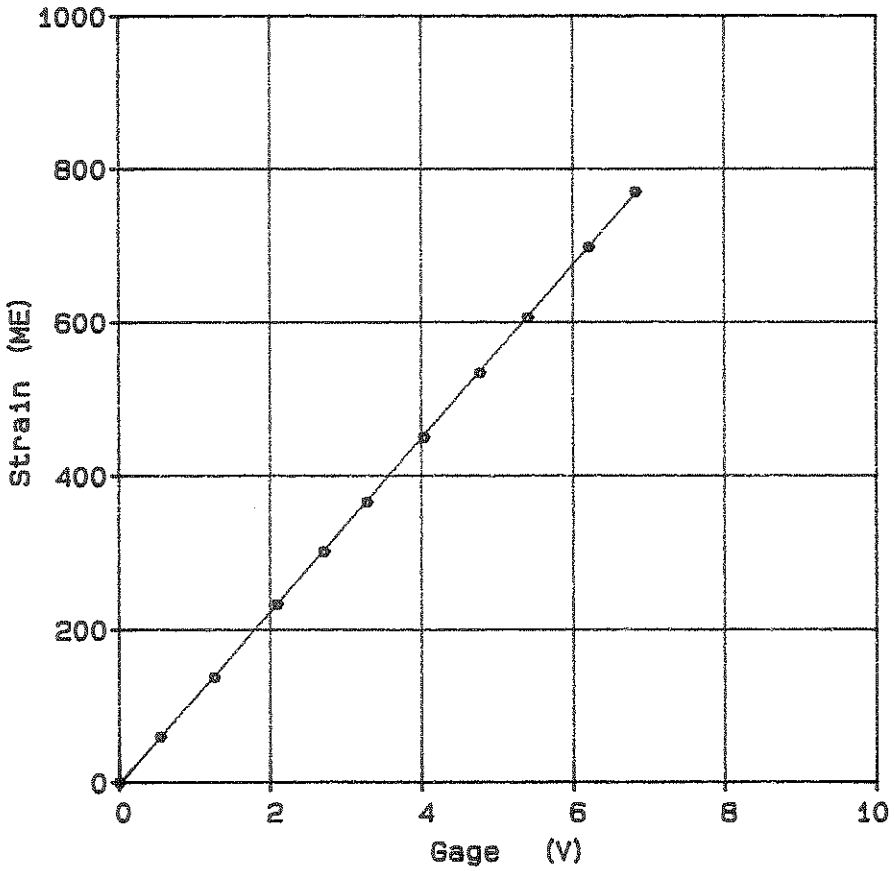

PDA Cal Factor = 112.7 ME/V
Shunt (60.4KΩ) = 5.0 V

General Factor = 391.3 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
60	.55
138	1.25
234	2.10
302	2.71
366	3.28
451	4.03
535	4.77
606	5.40
699	6.21
770	6.84

Calibrated by: Greg Tenich

Calibrated on: 25-Jul-94

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2