Pile Dynamics, Inc.

Transducer 205W

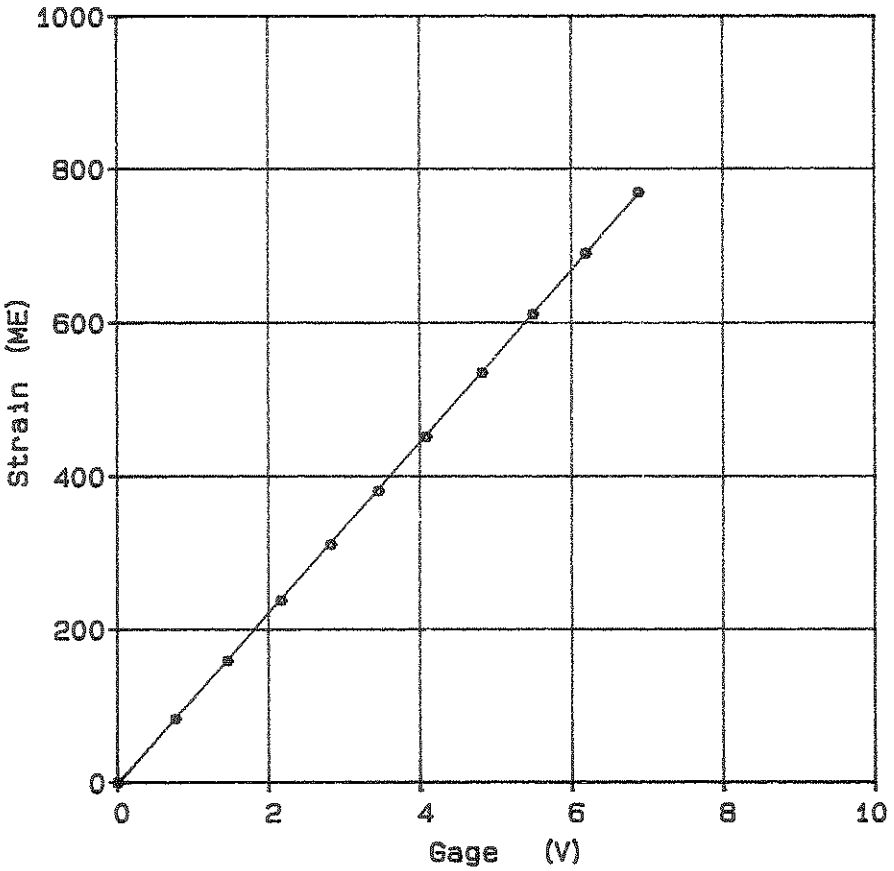

PDA Cal Factor	=	111.8 ME/V
Shunt (60.4KΩ)	=	5.0 V
General Factor	=	388.1 ME/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
84	.77
159	1.45
238	2.17
311	2.82
381	3.45
452	4.09
535	4.82
612	5.50
691	6.20
769	6.89

Calibrated by: Greg Tenah

Calibrated on: 25-Jul-94

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2