Pile Dynamics Inc
Transducer 206I

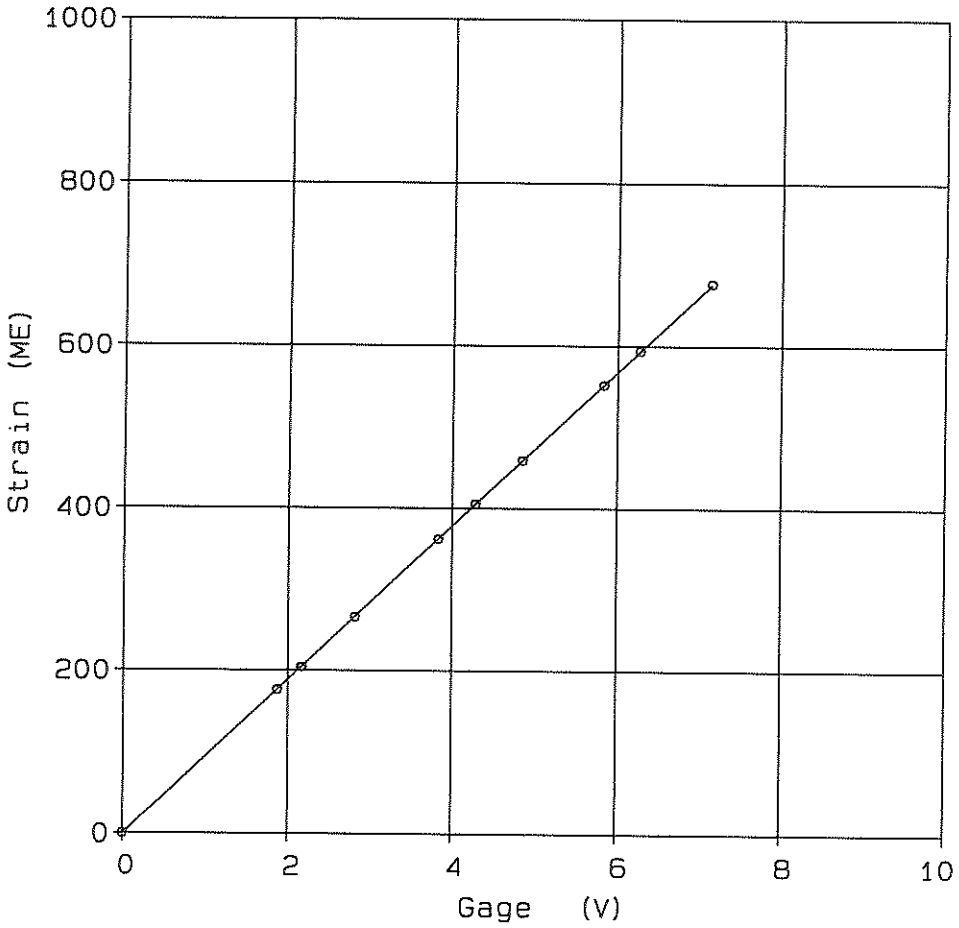

PDA Cal Factor = 94.9 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 329.5 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
176	1.87
205	2.17
204	2.17
266	2.82
362	3.84
406	4.29
460	4.86
553	5.84
594	6.27
677	7.15

Calibrated by: _____

Calibrated on: 13-May-02

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2