# Pile Dynamics Inc
# Transducer 207I

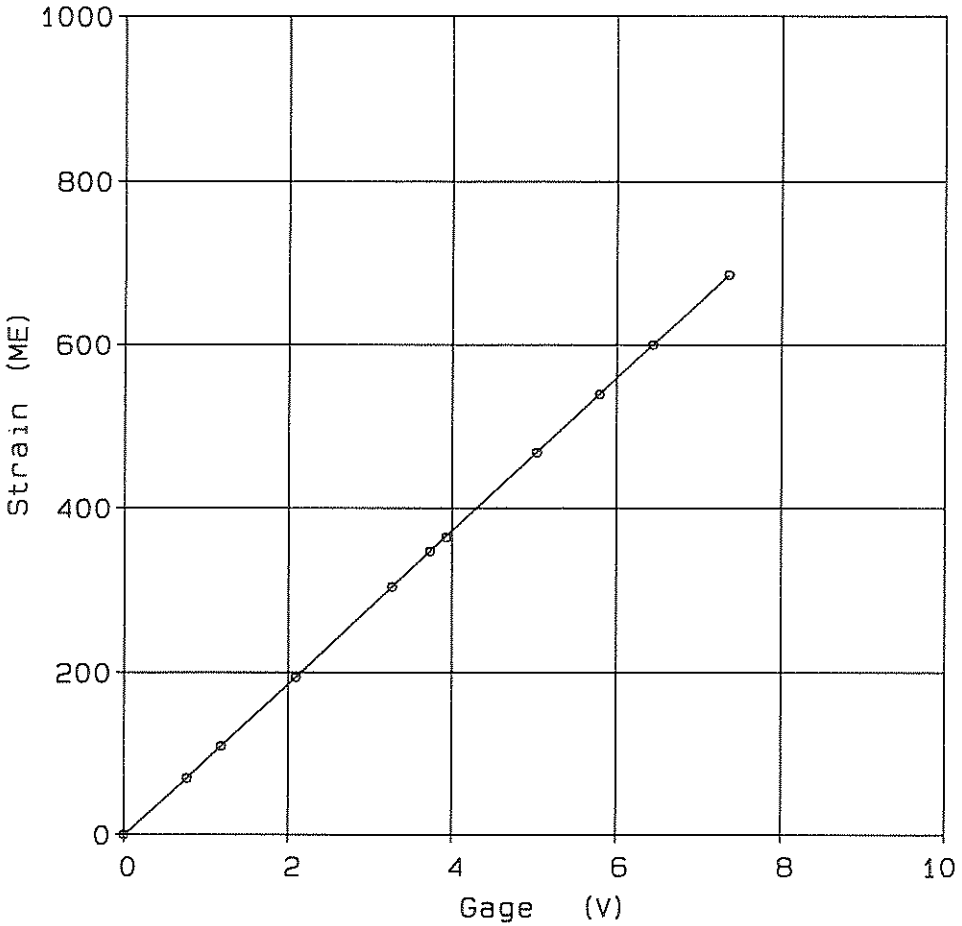


PDA Cal Factor = 93.3 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 323.9 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

| Strain ME | Gage V |
|---|---|
| 0 | .00 |
| 70 | .77 |
| 110 | 1.19 |
| 194 | 2.10 |
| 305 | 3.28 |
| 347 | 3.74 |
| 365 | 3.93 |
| 468 | 5.03 |
| 539 | 5.80 |
| 600 | 6.44 |
| 686 | 7.37 |

Calibrated by: J. Rausche

Calibrated on: 19-Jul-01

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2