Pile Dynamics, Inc.

Transducer 207W

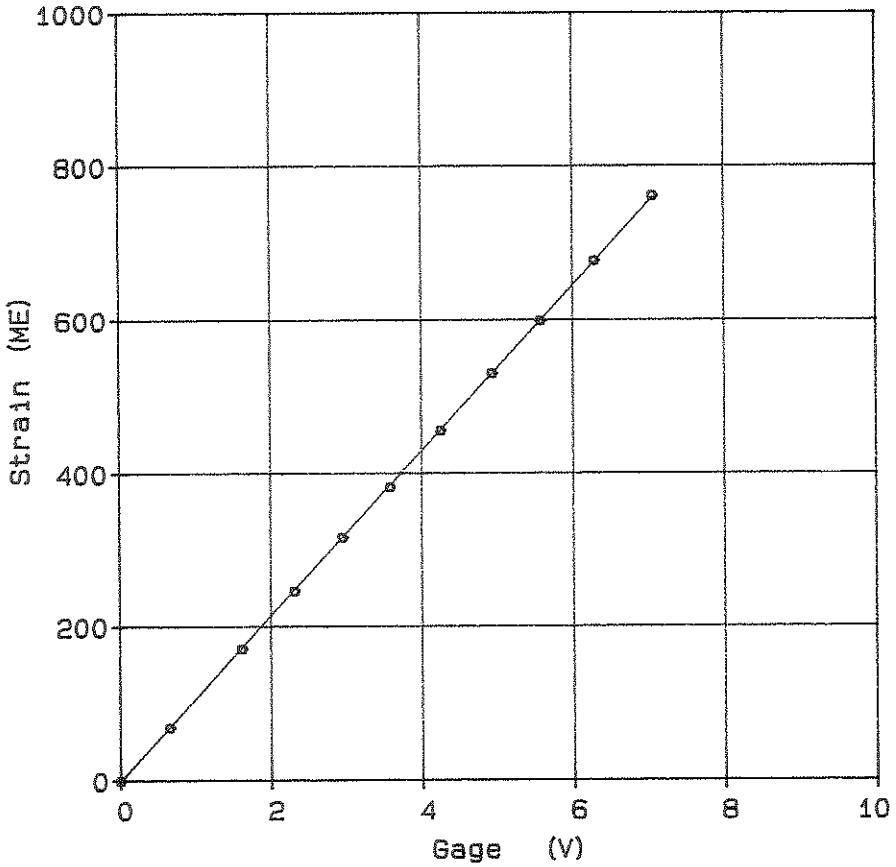

PDA Cal Factor = 107.9 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 374.6 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
70	.66
171	1.61
247	2.32
316	2.96
383	3.59
456	4.26
530	4.94
599	5.57
678	6.29
762	7.06

Calibrated by: Jim Deutschlaff

Calibrated on: 27-Jul-94

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2