Pile Dynamics, Inc.

Transducer 209I

Strain (με)

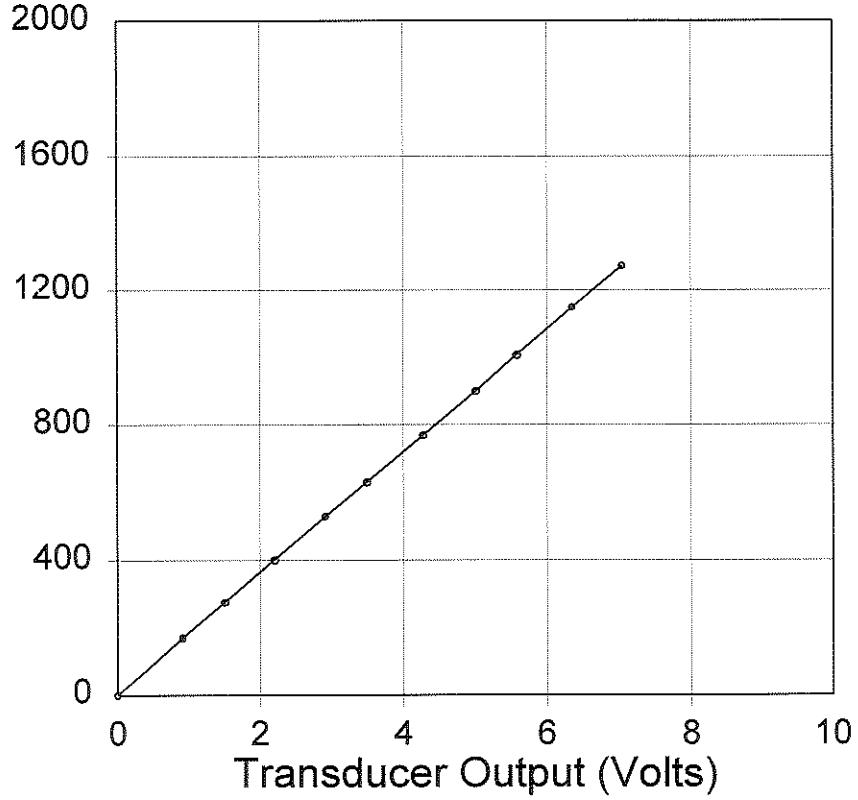

PDA Cal Factor (5.0 V) 89.9με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
171	0.91
274	1.50
398	2.19
528	2.92
628	3.49
767	4.27
899	5.00
1004	5.57
1149	6.35
1271	7.05

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 312.1με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by: Fred Hamm

Calibrated on: 16-Feb-2006

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2