Pile Dynamics Inc
Transducer 209

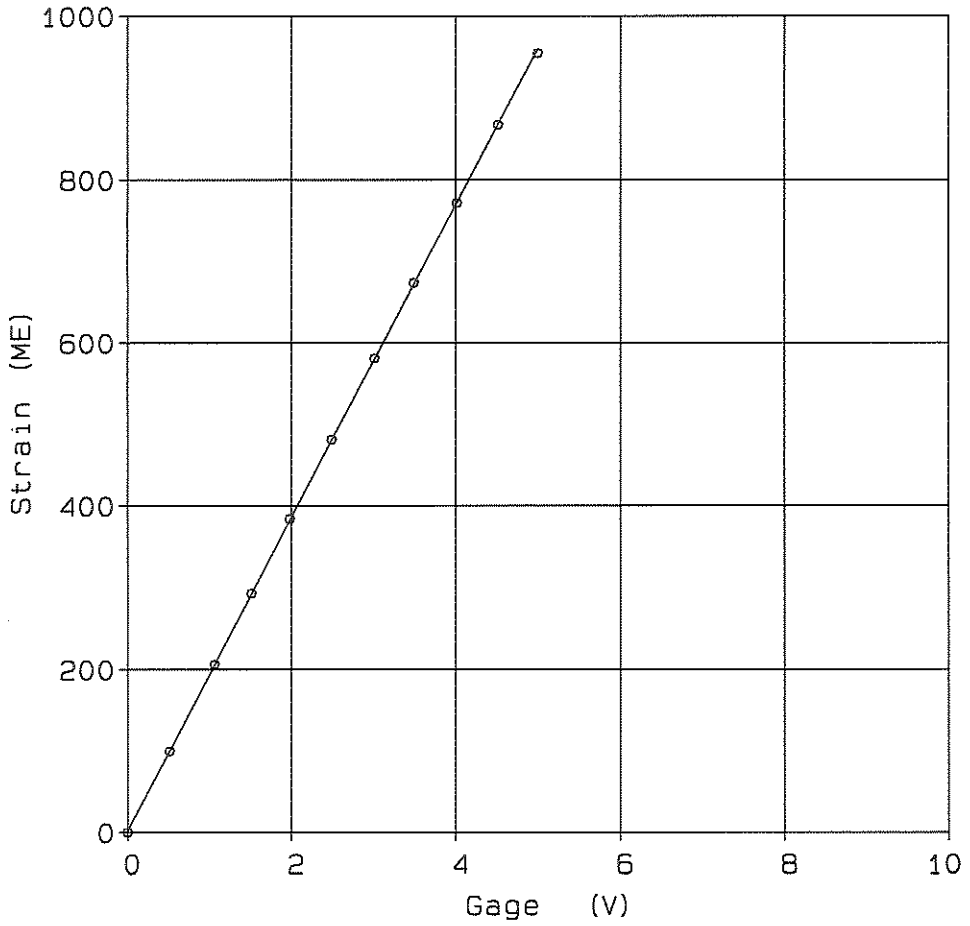

PDA Cal Factor	=	191.6 ME/V
Shunt (60.4KO)	=	5.0 V
General Factor	=	665.2 ME/mV/V

Strain ME	Gage V
0	.00
101	.52
207	1.06
294	1.51
385	1.99
481	2.49
582	3.02
674	3.50
773	4.01
868	4.52
956	5.00

Calibrated by: J. Garbin

Calibrated on: 28-Mar-03

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2