Pile Dynamics, Inc.

Transducer 211W

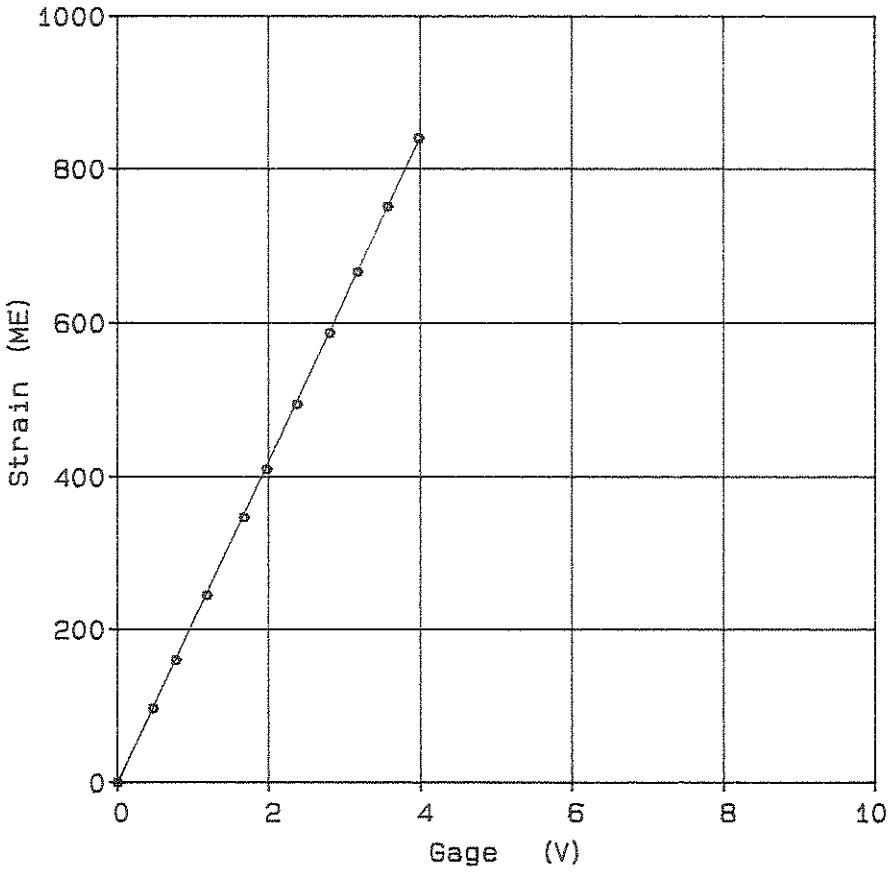

PDA Cal Factor = 210.8 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 732.0 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
97	.48
160	.78
245	1.19
347	1.67
410	1.98
495	2.37
587	2.81
666	3.18
751	3.58
841	3.99

Calibrated by: _____

Calibrated on: 25-Aug-94

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2