Pile Dynamics, Inc.
Transducer 212W

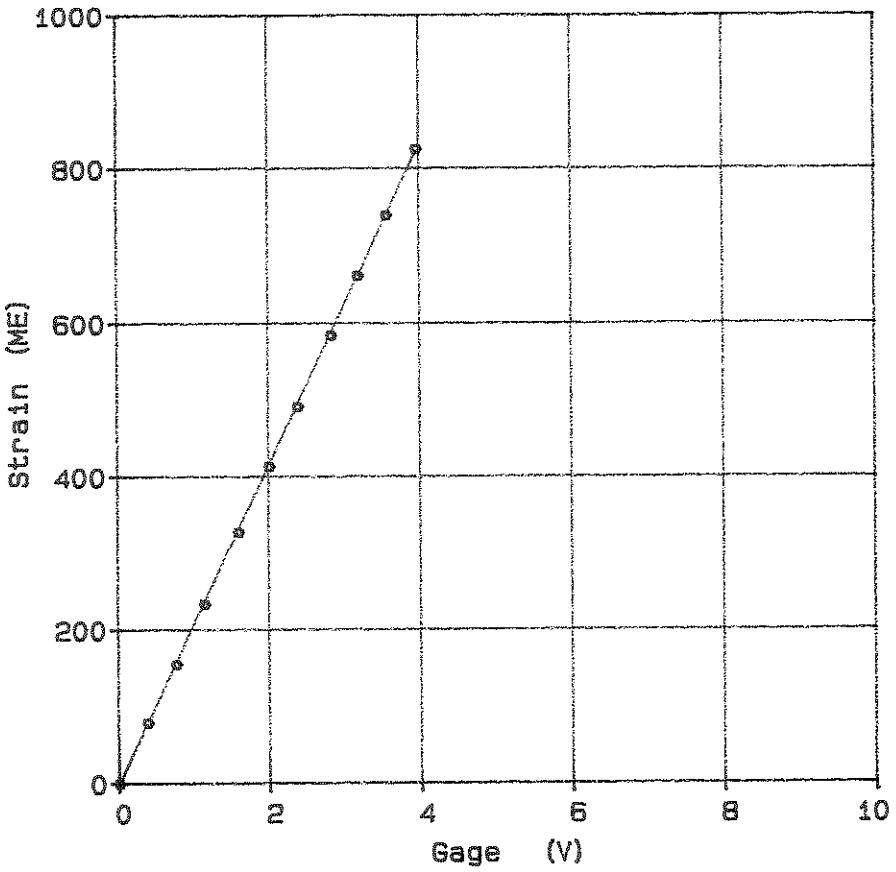

PDA Cal Factor = 208.2 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 723.0 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
80	.39
156	.76
233	1.14
328	1.60
413	2.01
492	2.39
585	2.83
661	3.19
740	3.56
826	3.97

Calibrated by: J. B. [signature]

Calibrated on: 25-Aug-94

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2