Pile Dynamics, Inc.

Transducer 213I

Strain (με)

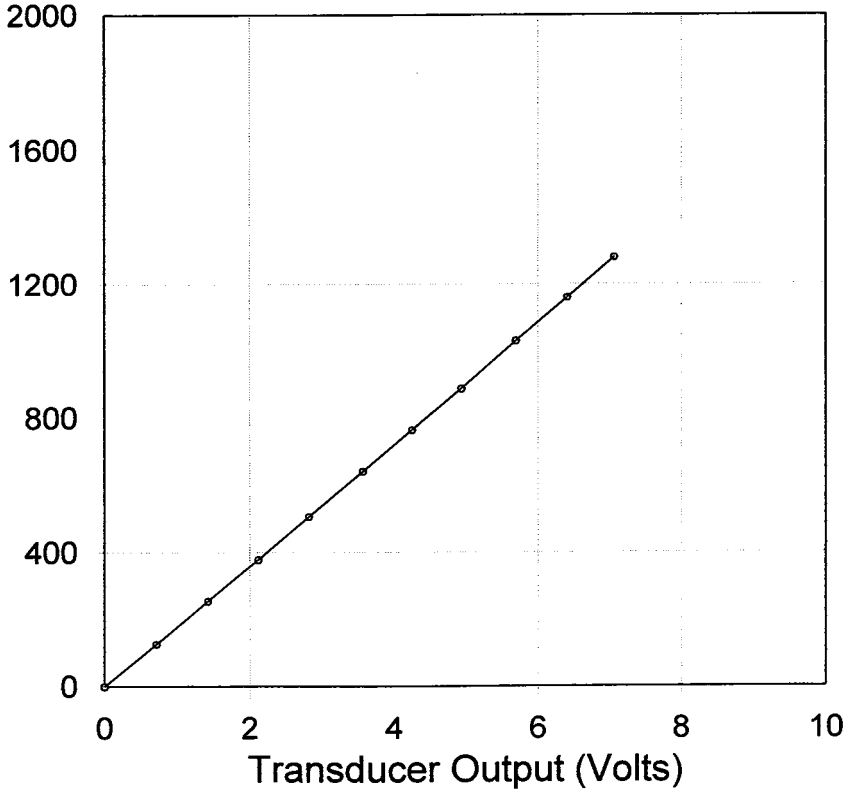

PDA Cal Factor (5.0 V) 90.6με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
126	0.71
254	1.42
378	2.12
506	2.83
640	3.57
762	4.25
887	4.93
1029	5.69
1160	6.41
1280	7.07

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 314.5με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by:

Calibrated on: 01-Oct-2014

Strain Transducer Calibrator System 2011 Version 1.5