Pile Dynamics, Inc.

Transducer 213W

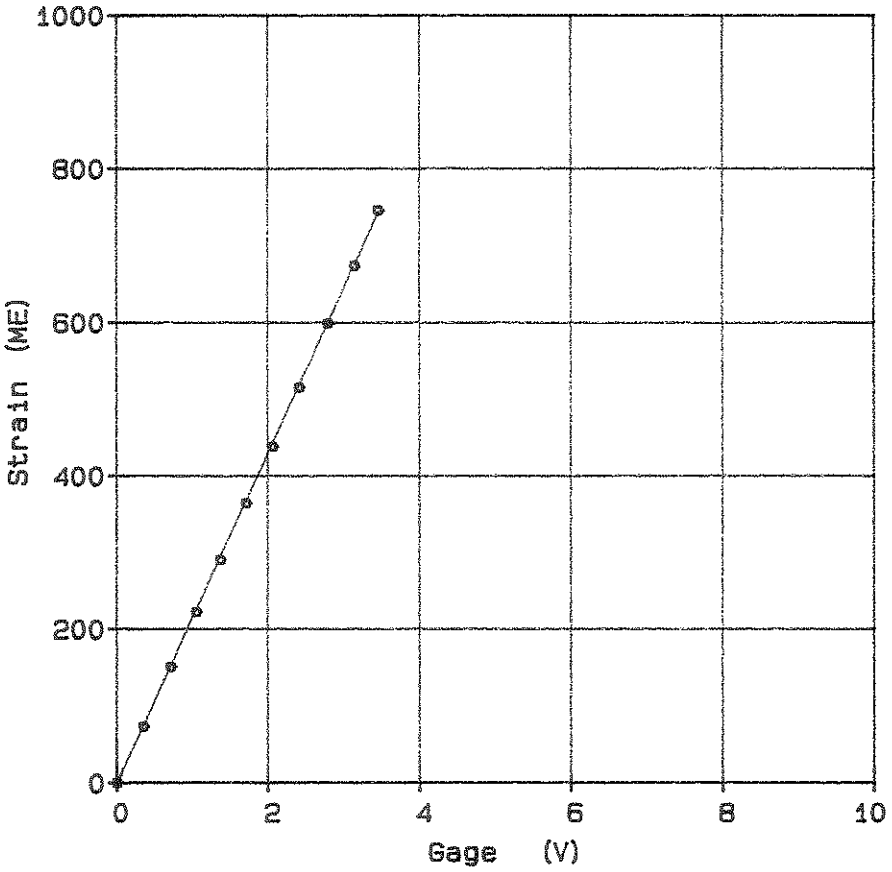

PDA Cal Factor	=	215.3 ME/V
Shunt (60.4KΩ)	=	5.0 V
General Factor	=	747.5 ME/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
75	.36
151	.72
223	1.06
290	1.37
365	1.72
439	2.06
515	2.41
600	2.80
675	3.14
747	3.47

Calibrated by: J. E. Deutschlaff

Calibrated on: 25-Aug-94

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2