Pile Dynamics, Inc.

Transducer 214W

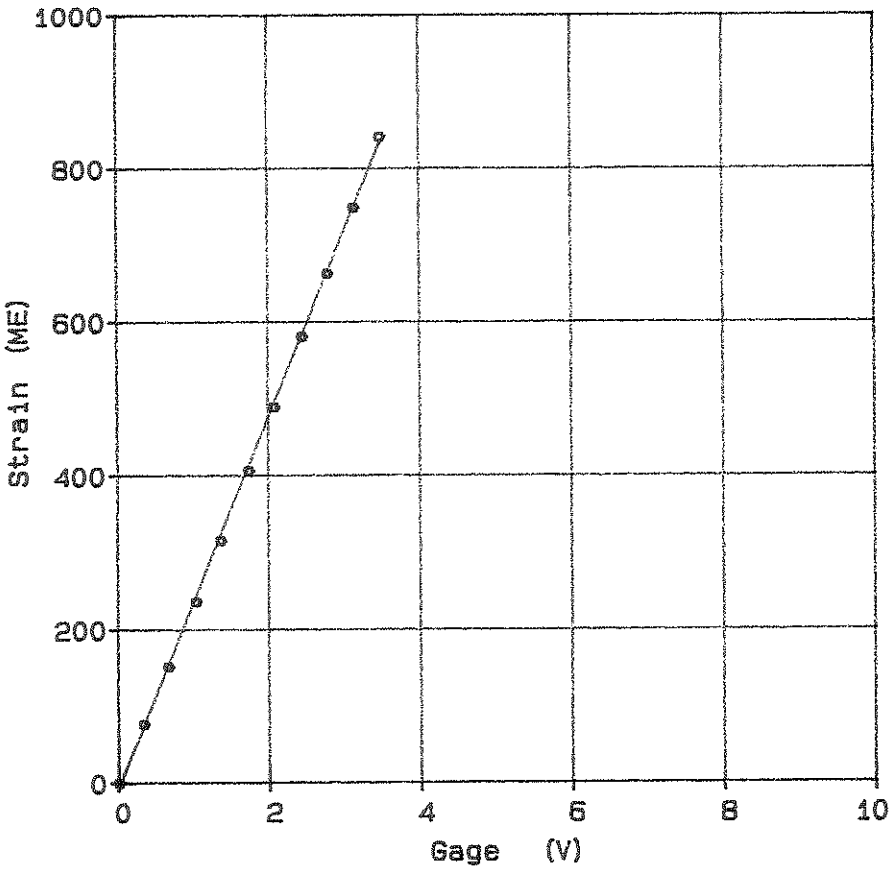

PDA Cal Factor = 241.3 ME/V
Shunt (60.4KΩ) = 5.0 V

General Factor = 837.9 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
77	.34
153	.67
237	1.03
315	1.36
406	1.74
489	2.08
581	2.45
663	2.78
750	3.13
841	3.49

Calibrated by: J. D. Rutledge

Calibrated on: 25-Aug-94

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2