Pile Dynamics, Inc.

Transducer 216W

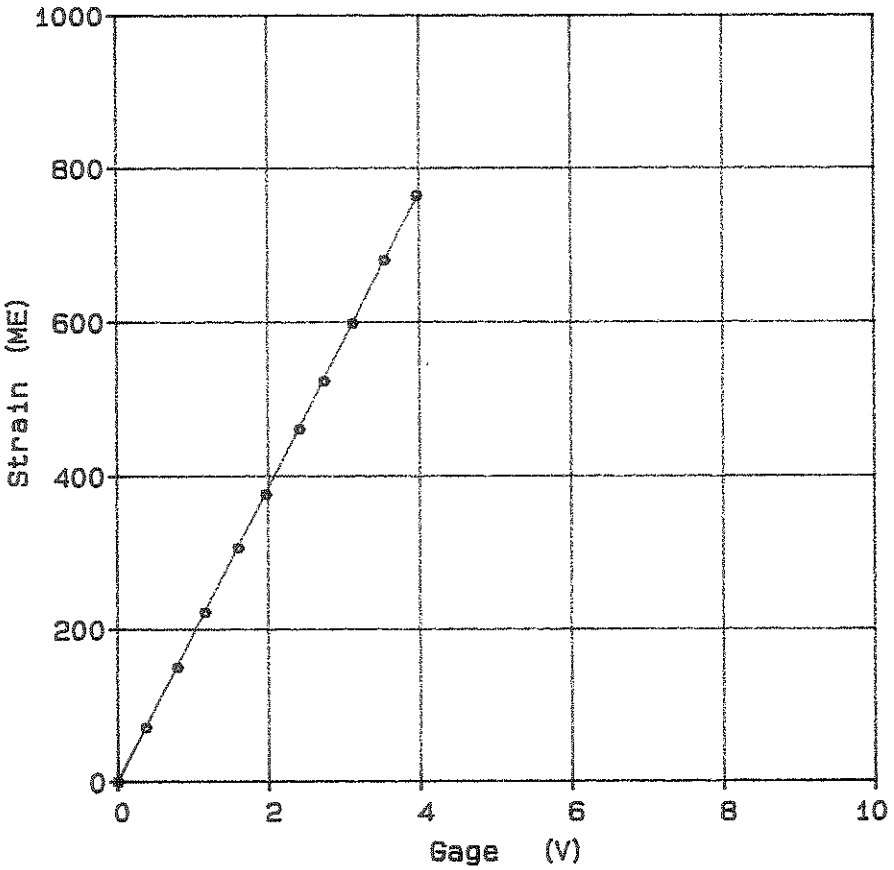

PDA Cal Factor = 192.0 ME/V
Shunt (60.4KΩ) = 5.0 V

General Factor = 666.8 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
71	.38
151	.79
223	1.17
307	1.61
377	1.98
462	2.42
524	2.74
599	3.13
680	3.55
764	3.98

Calibrated by: _____

Calibrated on: 25-Aug-94

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2