Pile Dynamics, Inc.

Transducer 218W

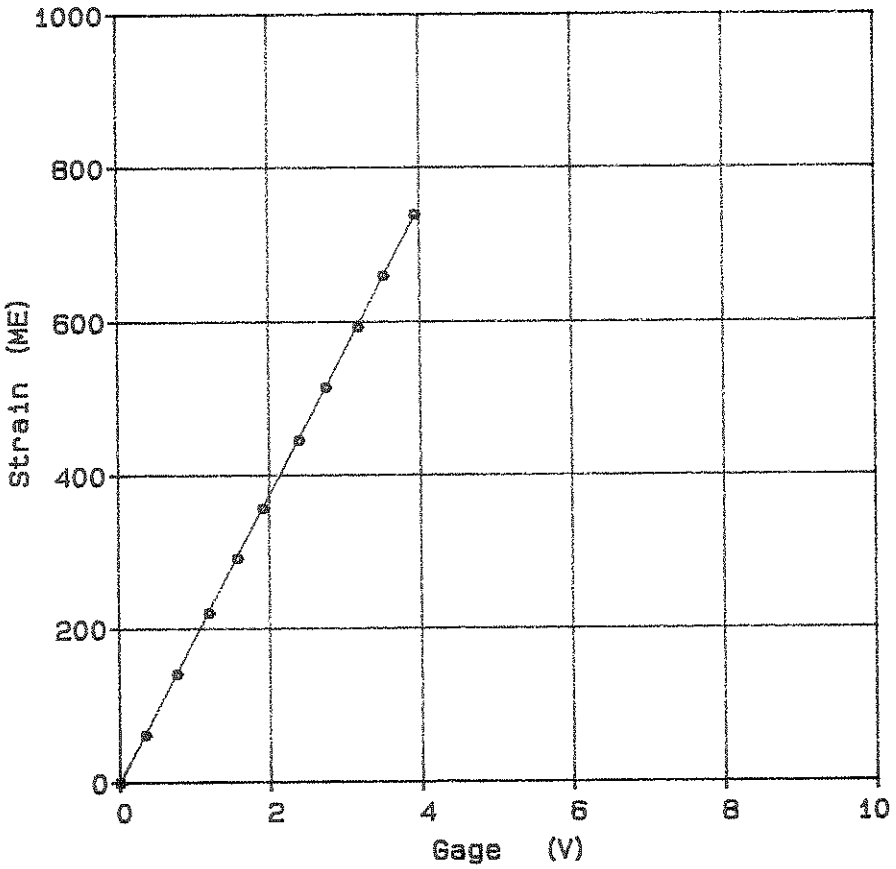

PDA Cal Factor = 187.3 ME/V
Shunt (60.4KΩ) = 5.0 V

General Factor = 650.2 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
63	.34
141	.76
220	1.19
292	1.57
356	1.92
445	2.39
514	2.76
594	3.18
660	3.53
739	3.95

Calibrated by: _____

Calibrated on: 25-Aug-94

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2