Pile Dynamics Inc
Transducer 220W

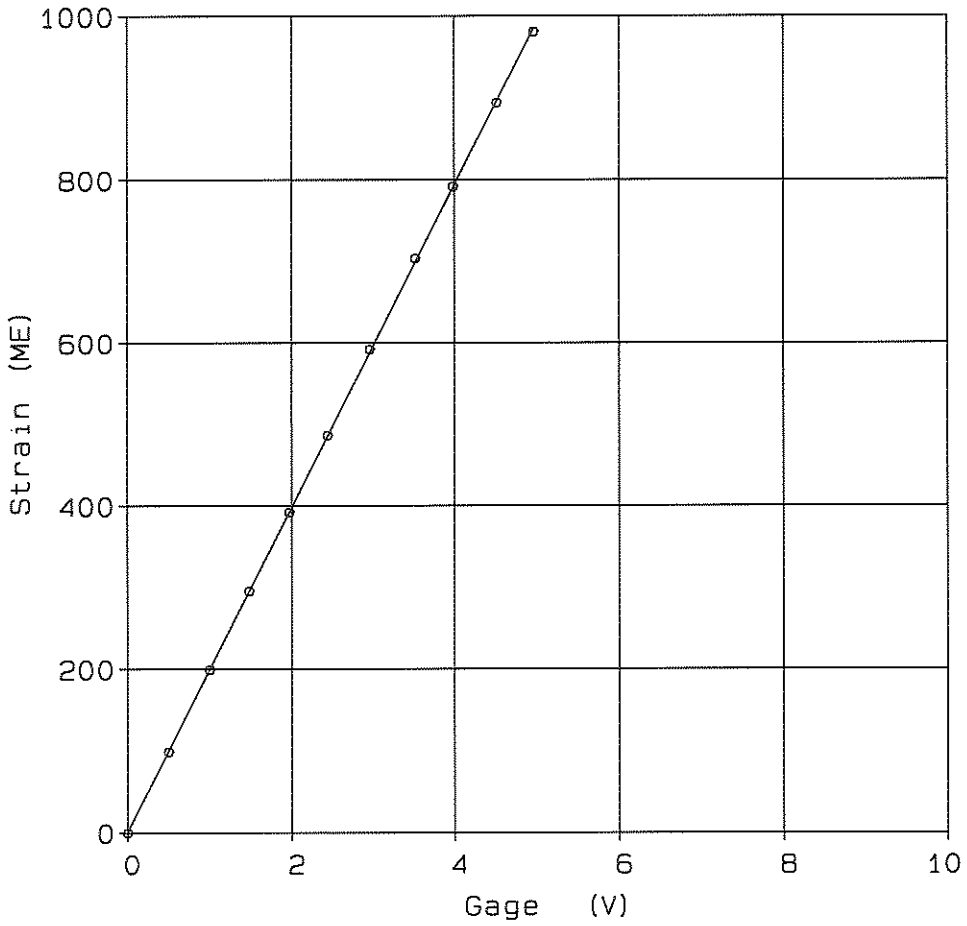

PDA Cal Factor = 198.5 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 689.3 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
99	.50
200	1.00
295	1.49
393	1.97
486	2.44
593	2.97
704	3.53
793	3.98
895	4.51
982	4.96

Calibrated by: _____

Calibrated on: 28-Mar-03

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2