Pile Dynamics, Inc.
Transducer 222W

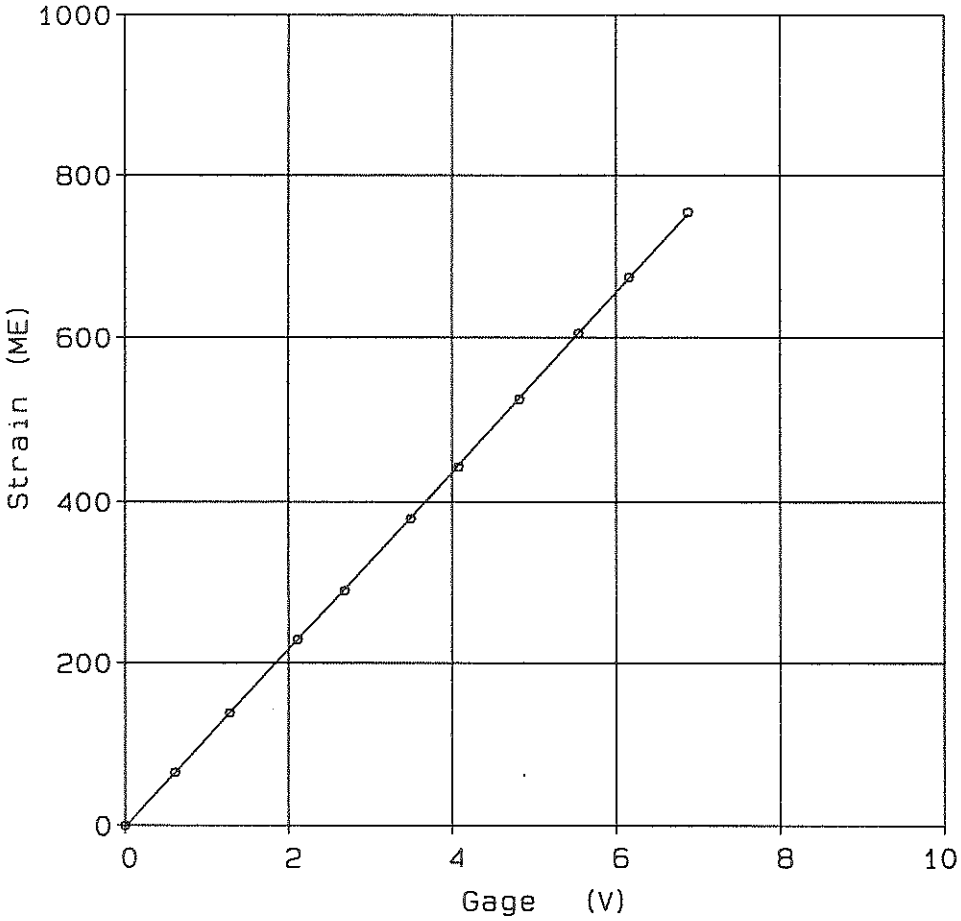

PDA Cal Factor = 109.6 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 380.4 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T. *

Strain ME	Gage V
0	.00
66	.62
138	1.28
229	2.12
290	2.68
379	3.50
443	4.08
526	4.83
606	5.55
674	6.17
754	6.89

Calibrated by: Jim Deutschoff

Calibrated on: 01-Nov-94

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2