Pile Dynamics, Inc.
Transducer 224W

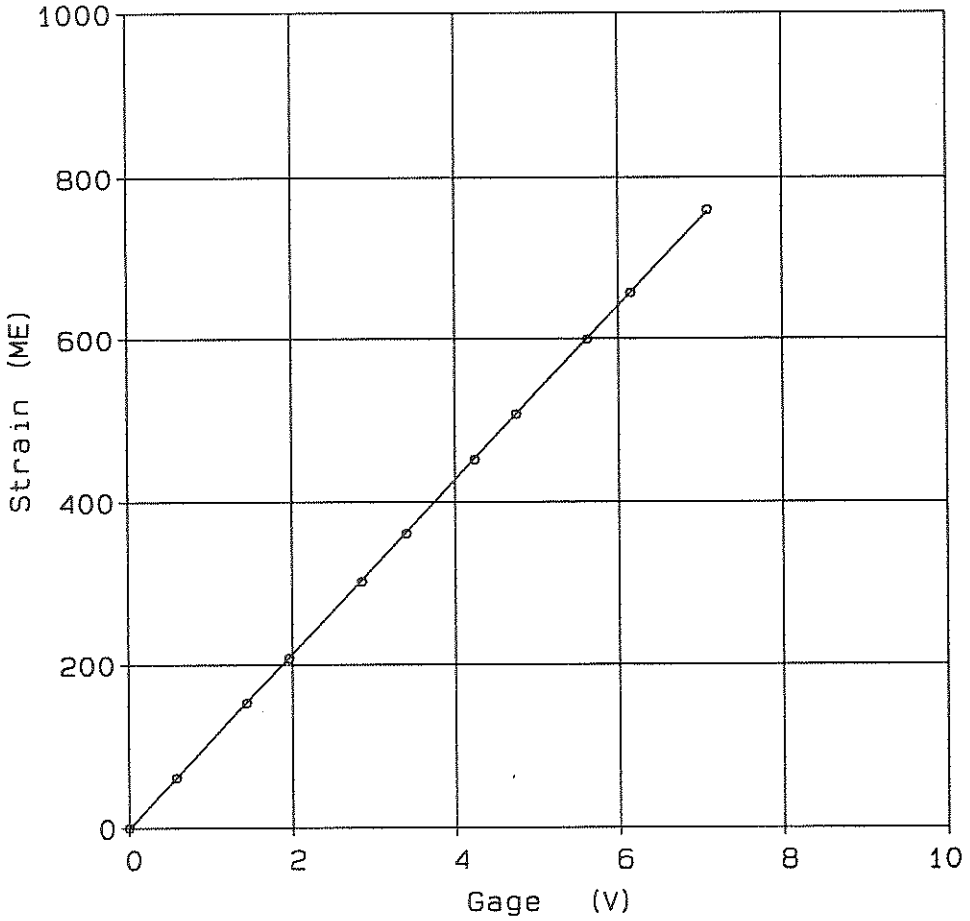

PDA Cal Factor	=	107.1 ME/V
Shunt (60.4KO)	=	5.0 V
General Factor	=	372.0 ME/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
62	.59
152	1.44
208	1.97
303	2.86
361	3.40
452	4.25
507	4.76
600	5.62
658	6.15
760	7.10

Calibrated by: Jim Deutschoff

Calibrated on: 01-Nov-94

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2