Pile Dynamics, Inc.
Transducer 225W

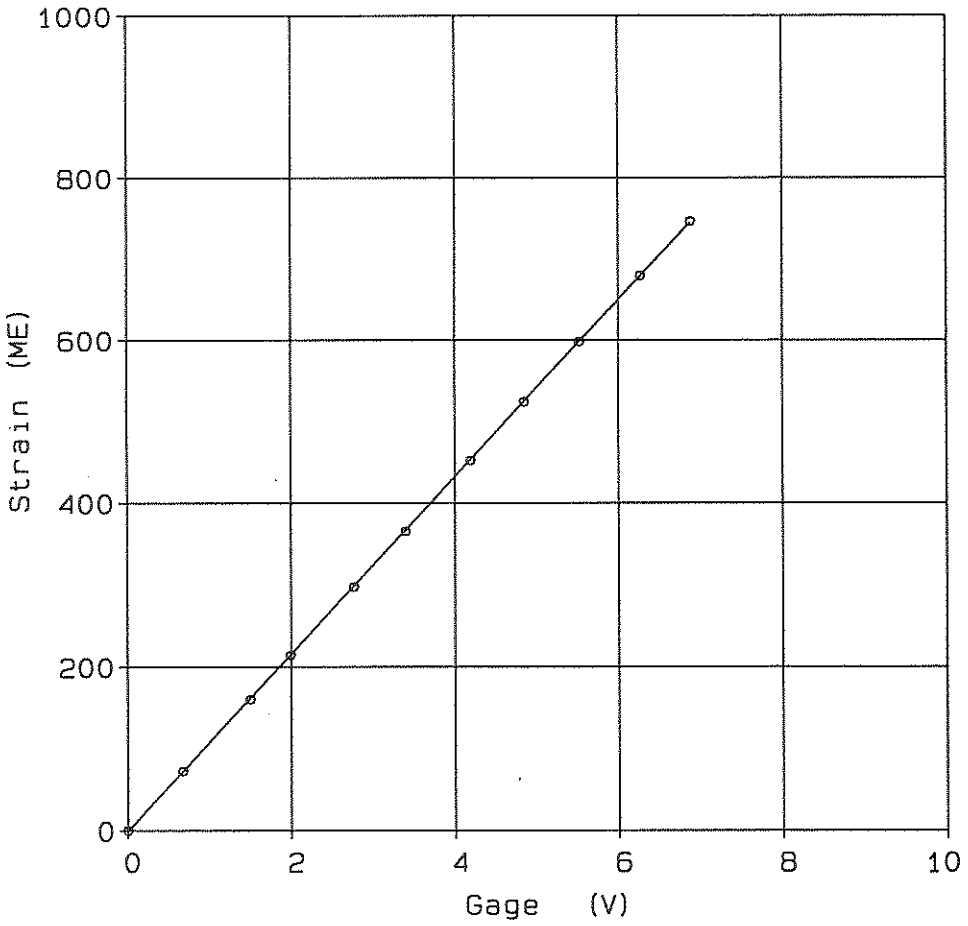

PDA Cal Factor = 108.6 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 377.0 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
72	.68
161	1.50
214	2.00
298	2.77
365	3.40
452	4.20
525	4.86
599	5.53
680	6.28
747	6.88

Calibrated by: Jim Deutschtroff

Calibrated on: 01-Nov-94

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2