Pile Dynamics, Inc.

Transducer 226W

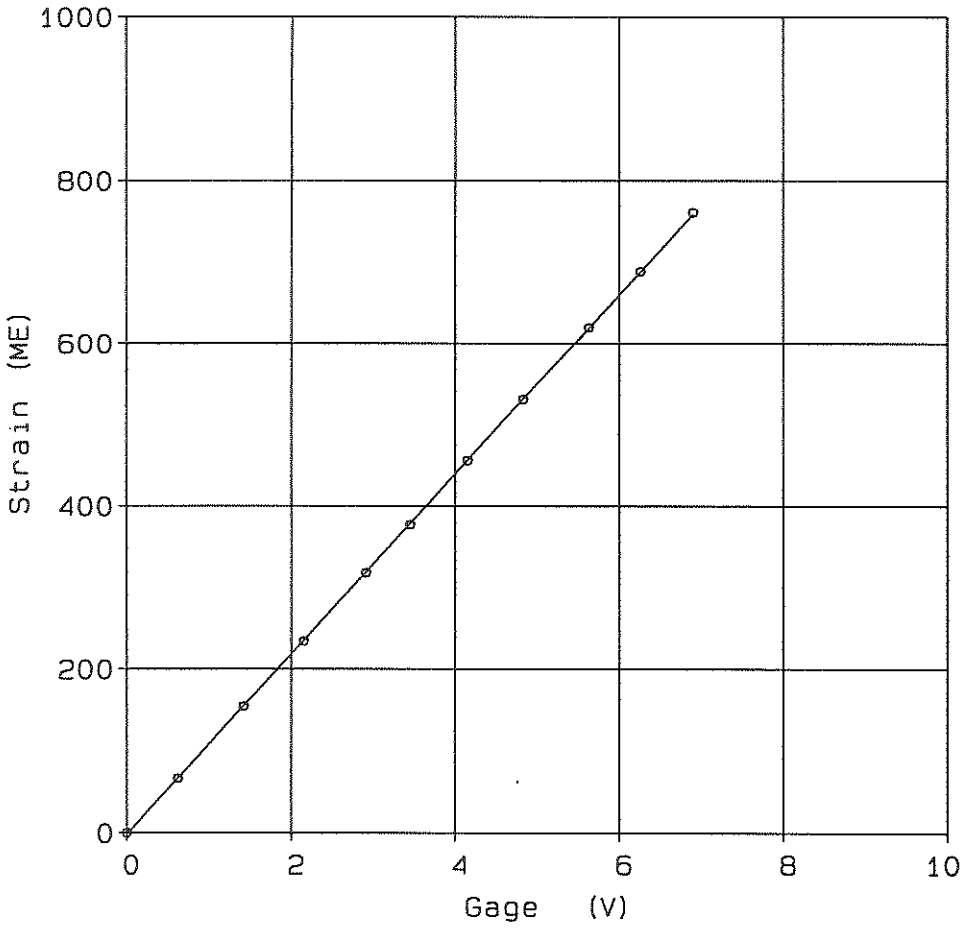

PDA Cal Factor = 110.4 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 383.2 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
67	.62
154	1.42
234	2.15
319	2.92
378	3.46
456	4.16
530	4.83
620	5.64
690	6.26
762	6.91

Calibrated by: Jim Rausche

Calibrated on: 01-Nov-94

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2